

MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 12:33:47

Durée: 5mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE BANGALY
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	CR18
ID	25031012294119008

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

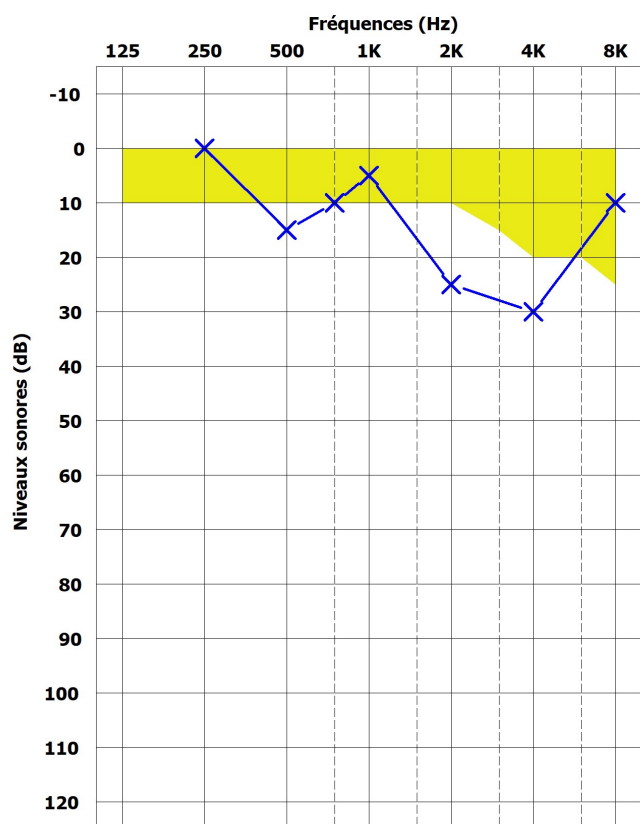

Oreille Gauche

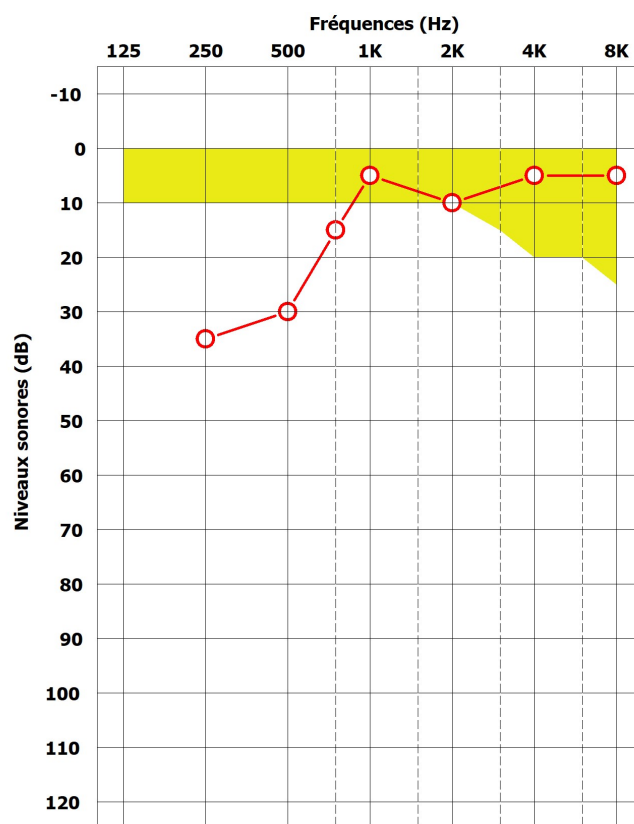

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	10	5		25		30		10
CA Droit		35	30	15	5		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes