

MEDVIE

Date du test: 10/07/2025 15:37:18

Durée: 4mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

TRAORE SIDIKI

Date de naissance

05/03/1992

Age

33

Société

CR18

ID

25071015331031553

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

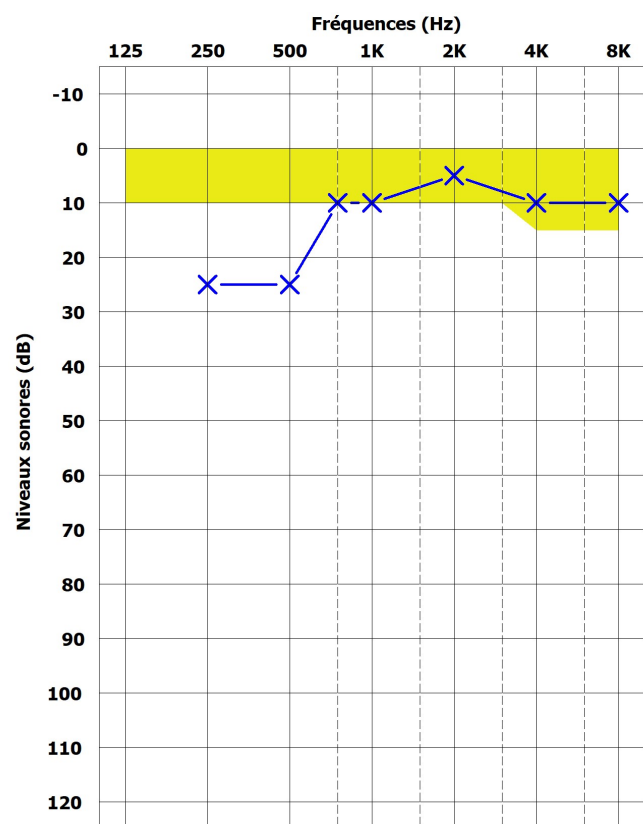

Oreille Gauche

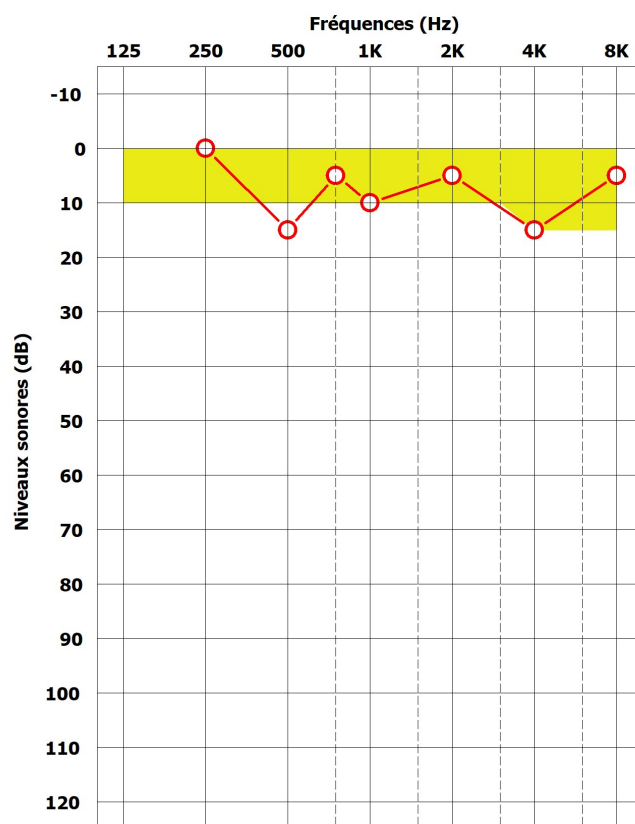

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	10		5		10		10
CA Droit		0	15	5	10		5		15		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes