


MEDVIE


Date du test: 01/06/2024 15:25:06
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	01/01/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24060115205218398

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

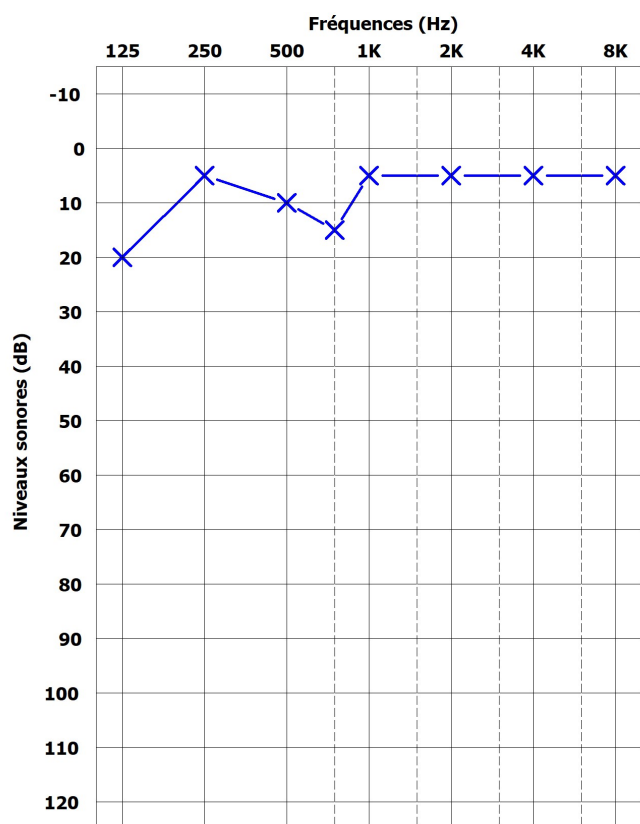

Oreille Gauche

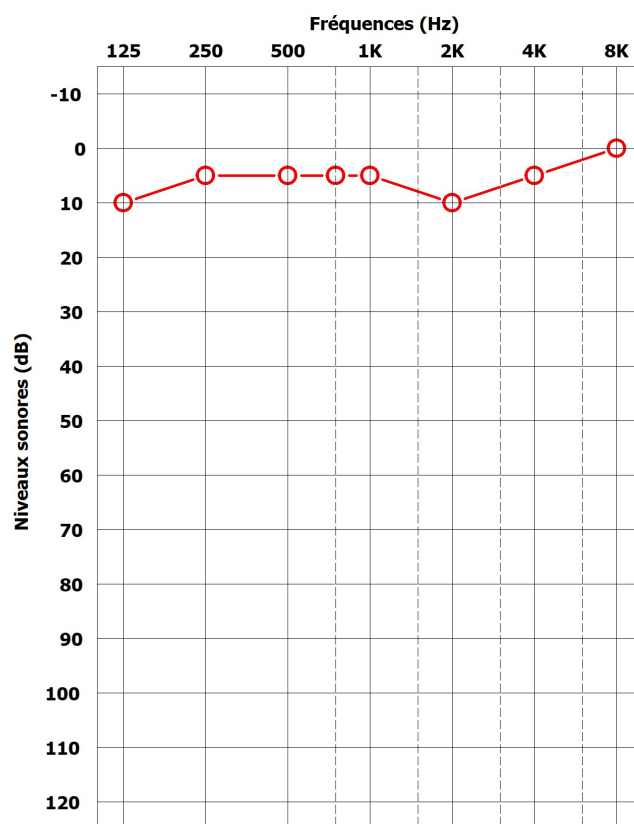

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	15	5		5		5		5
CA Droit	10	5	5	5	5		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes