

MEDVIE


Date du test: 05/08/2025 14:39:15

Durée: 4mn 22s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		FOFANA MORY
Date de naissance	01/01/2000	
Age	25	
Société	CR18	
ID	25080514362597035	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

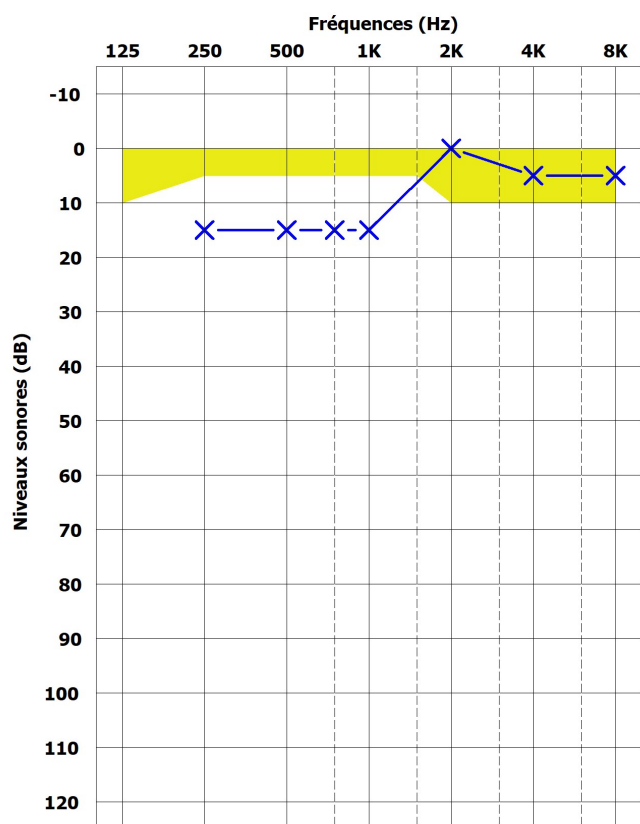

Oreille Gauche

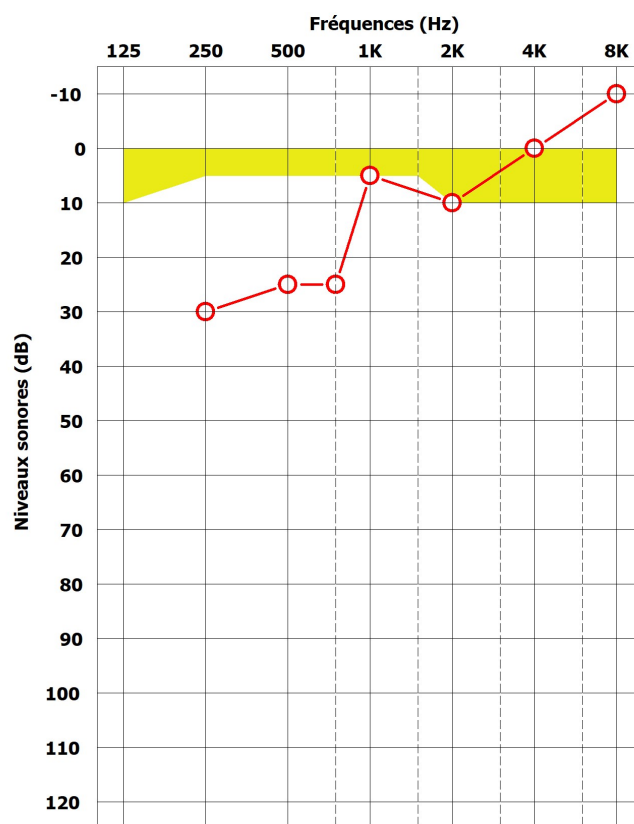

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	15		0		5		5
CA Droit		30	25	25	5		10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes