

MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:37:12

Durée: 5mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	HUANG RENKE
Date de naissance	09/04/1986
Age	38
Société	CR18
ID	25031812353875486

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

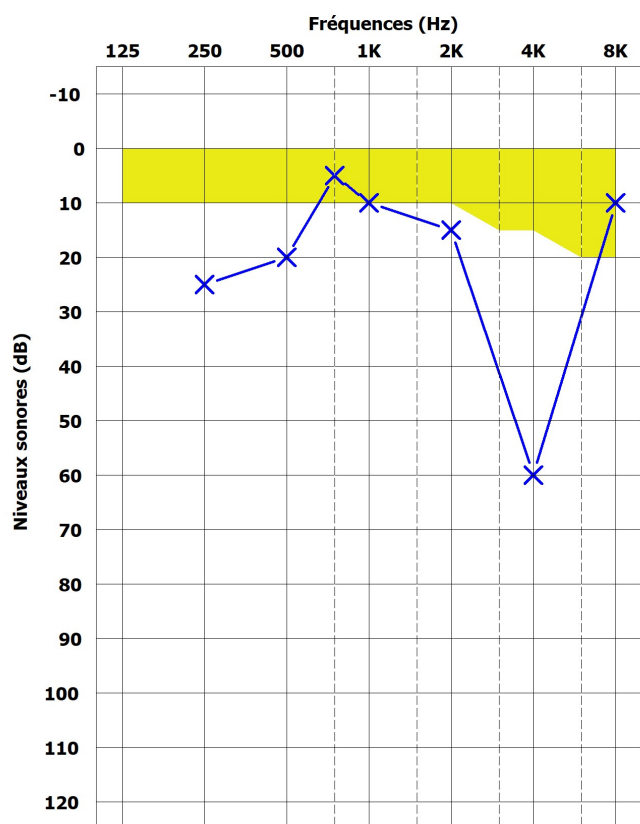

Oreille Gauche

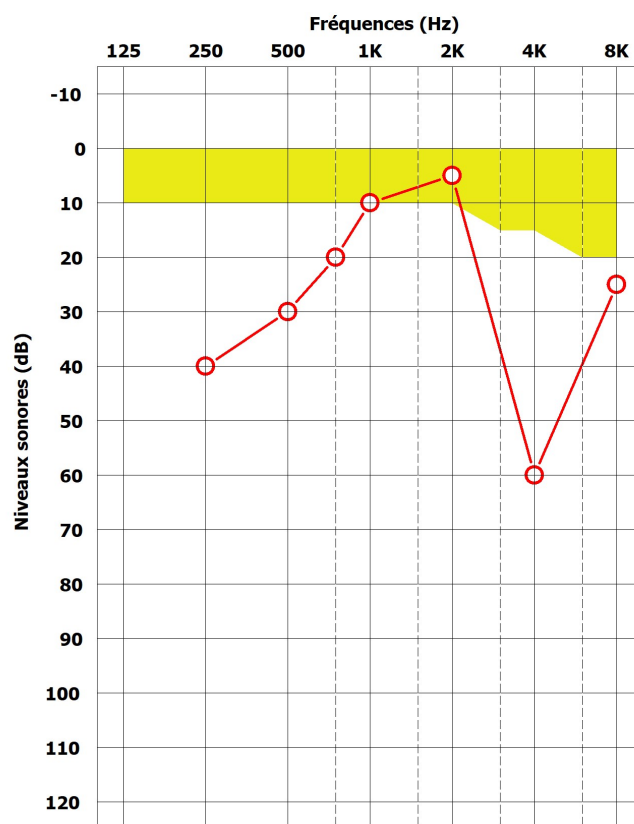

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	5	10		15		60		10
CA Droit		40	30	20	10		5		60		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes