


MEDVIE


Date du test: 26/08/2025 13:19:29
Durée: 3mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO YOUSOUF	
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25082612531388688

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

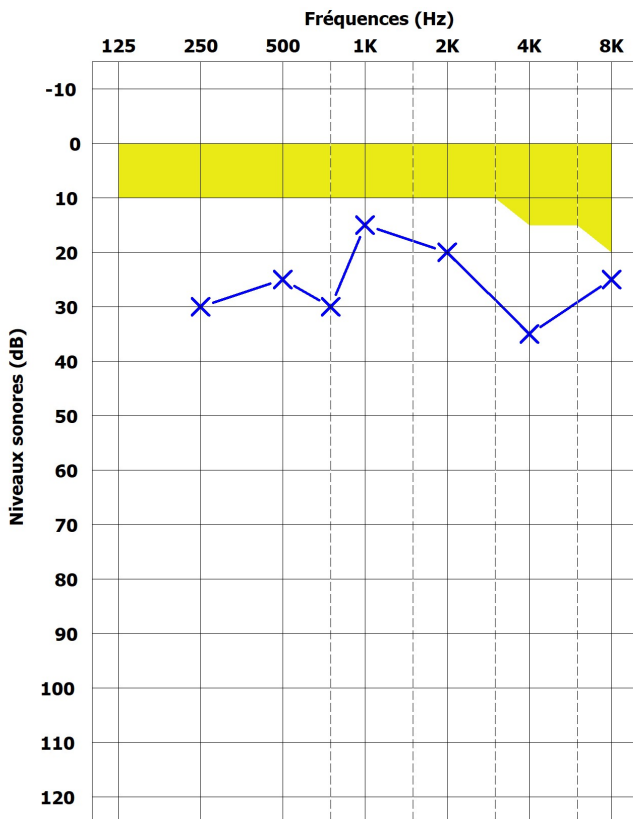

Oreille Gauche

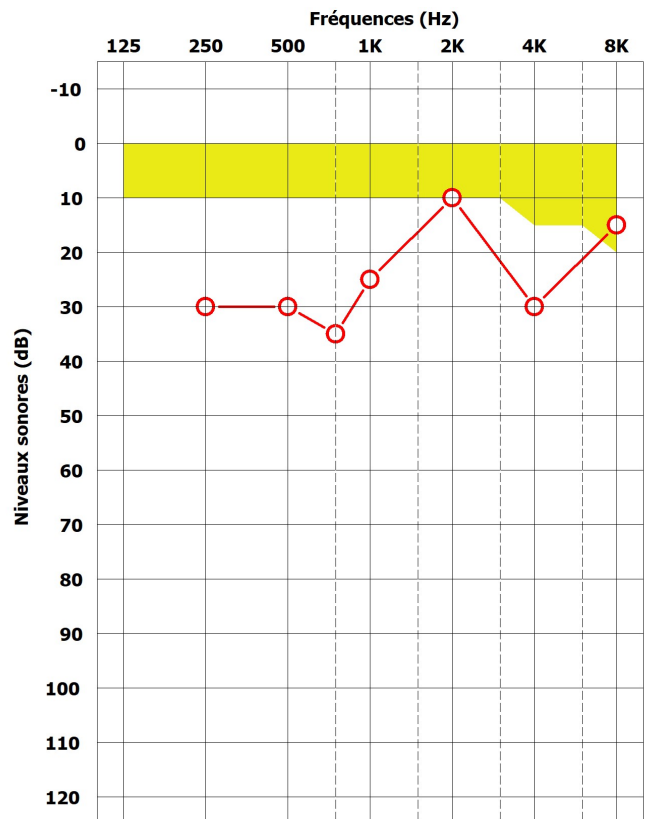

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	30	15		20		35		25
CA Droit		30	30	35	25		10		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes