


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 09:30:26
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KONATE FILANY
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24051709145218304

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

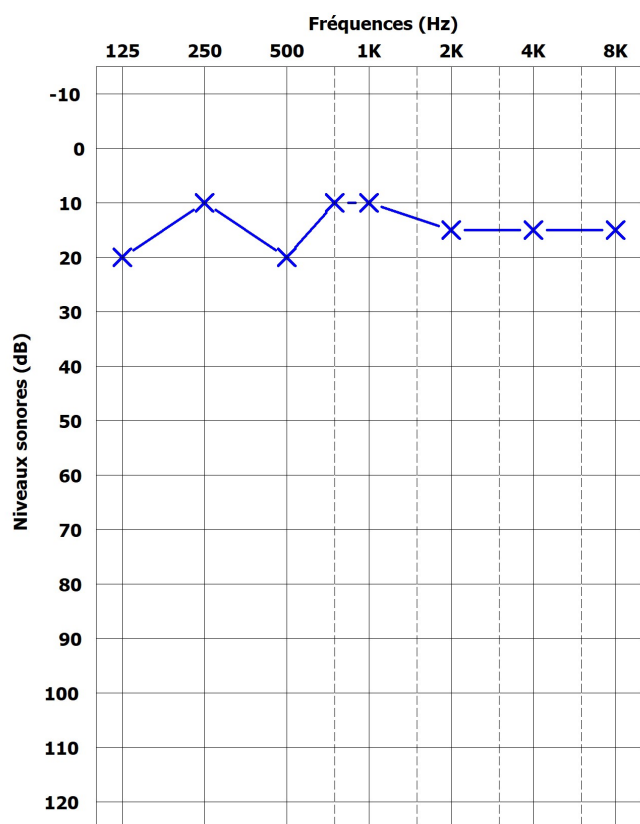

Oreille Gauche

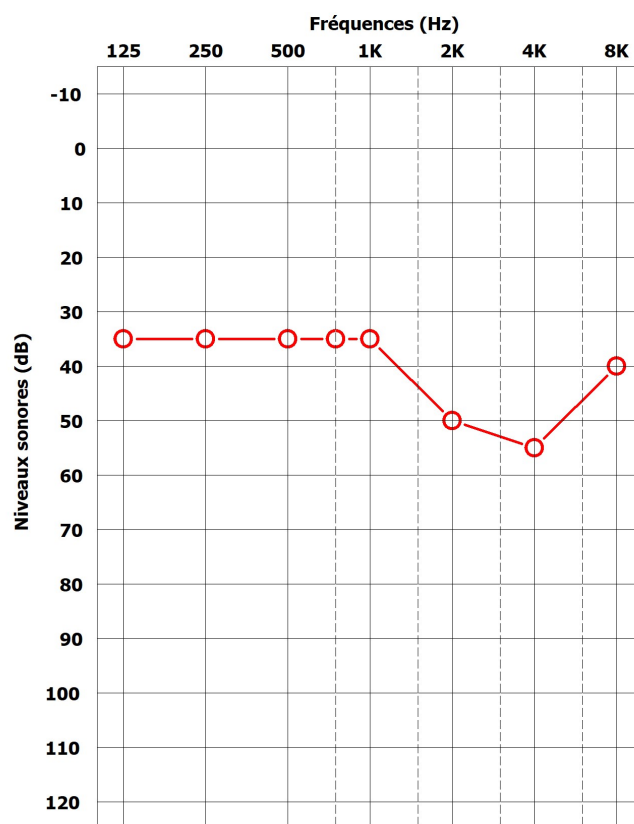

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	20	10	10		15		15		15
CA Droit	35	35	35	35	35		50		55		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	43,8 dB	---

Notes