


MEDVIE


Date du test: 01/06/2024 16:37:43
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		FOFANA ALY
Date de naissance		01/01/1998
Age		26
Société		CR18
ID		24060116365131795

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

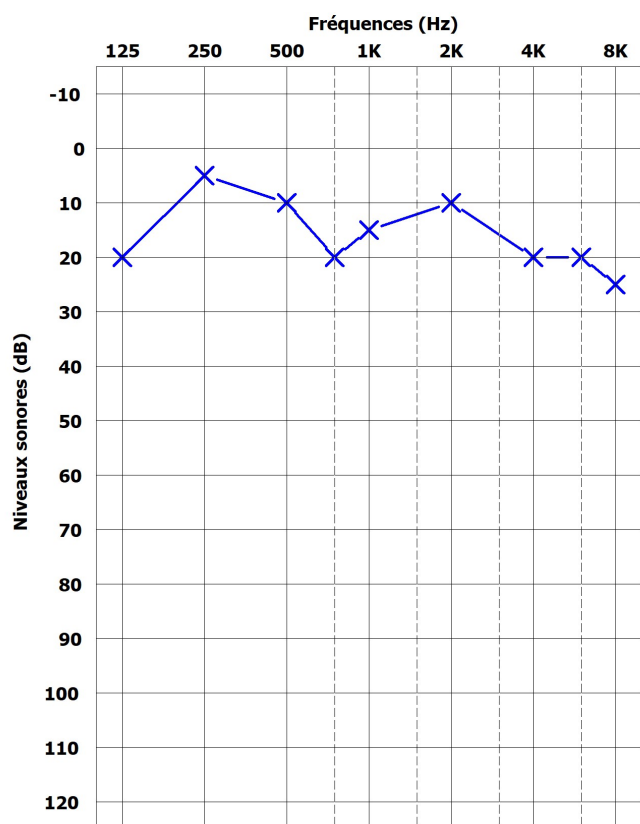

Oreille Gauche

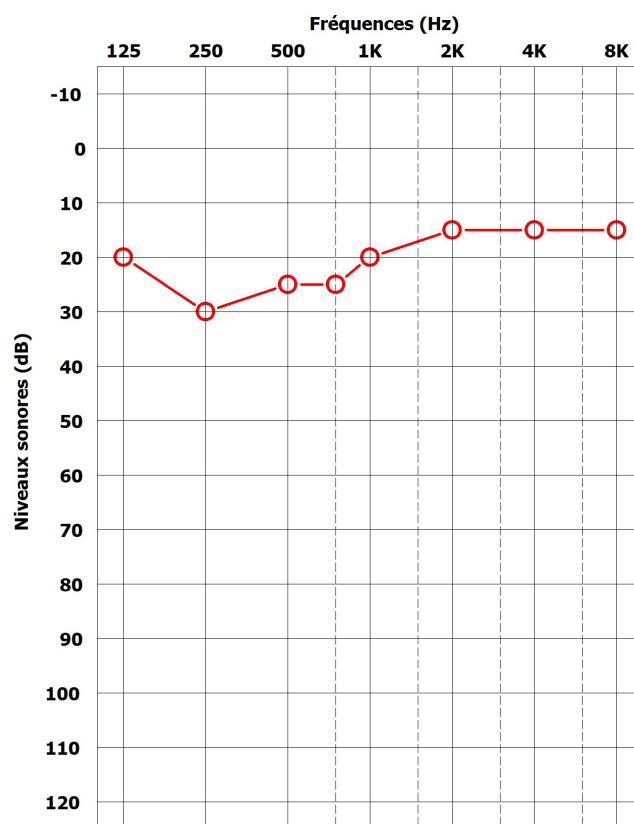

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	20	15		10		20	20	25
CA Droit	20	30	25	25	20		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes