


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 12:46:08

Durée: 5mn 33s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

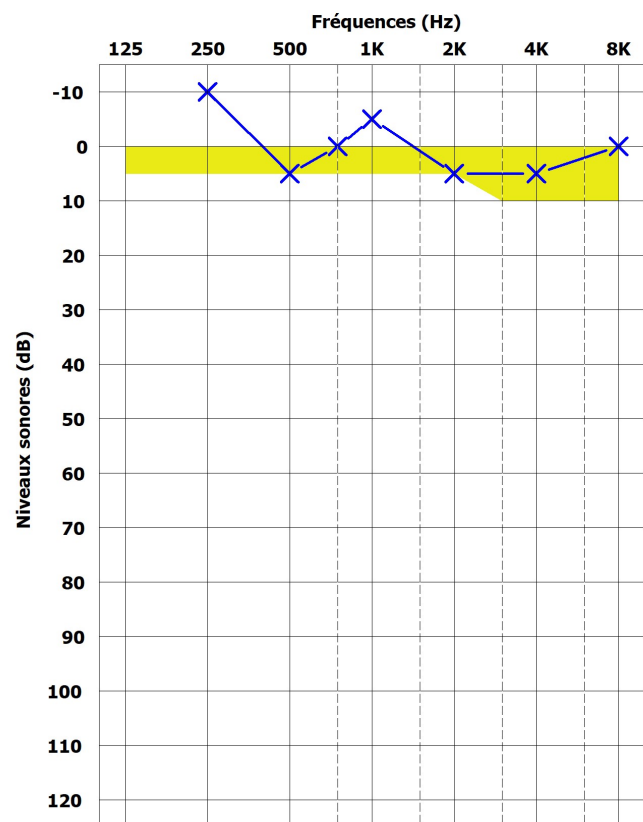

Oreille Gauche

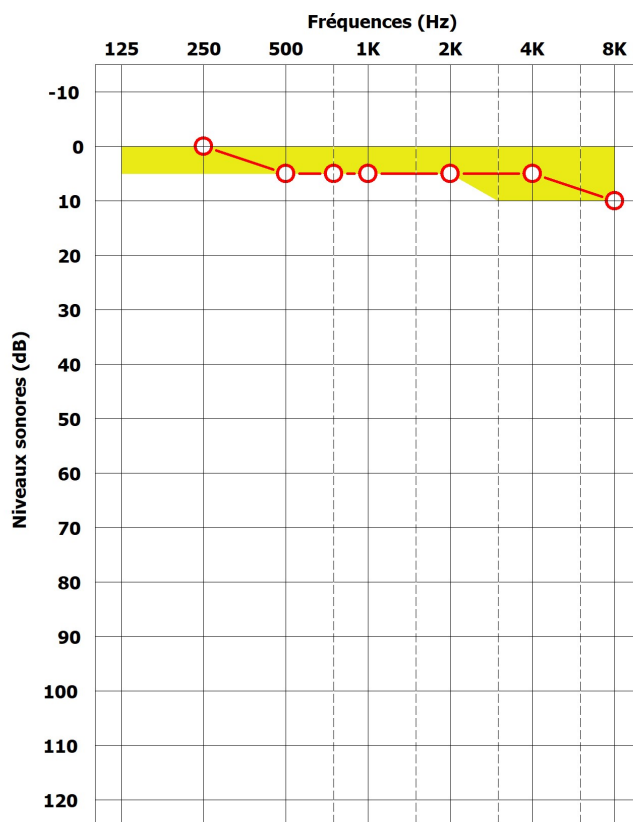

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	0	-5		5		5		0
CA Droit		0	5	5	5		5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SORY
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24093012235237962

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021