


MEDVIE


Date du test: 24/05/2024 14:27:00
 Durée: 2mn 11s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
SANOH AYOUBA	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24052414240530182

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

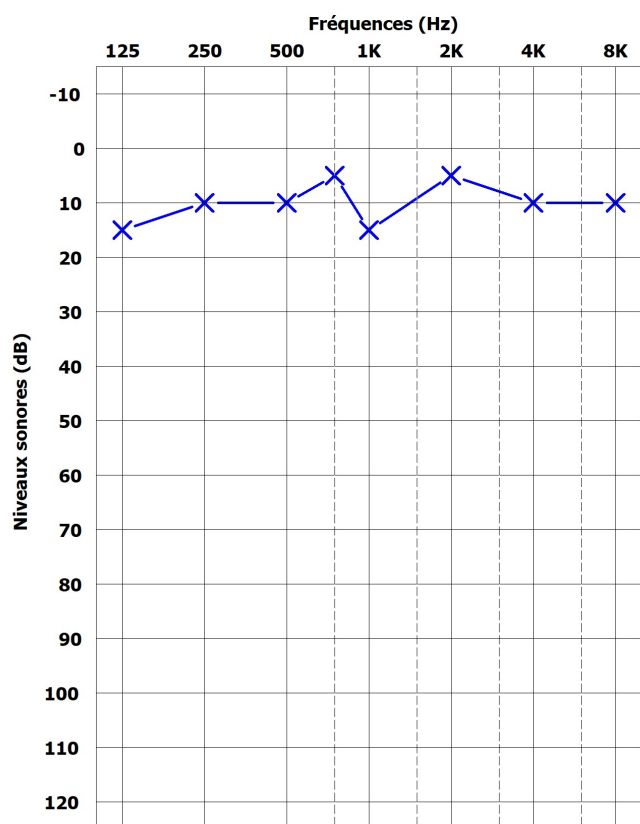

Oreille Gauche

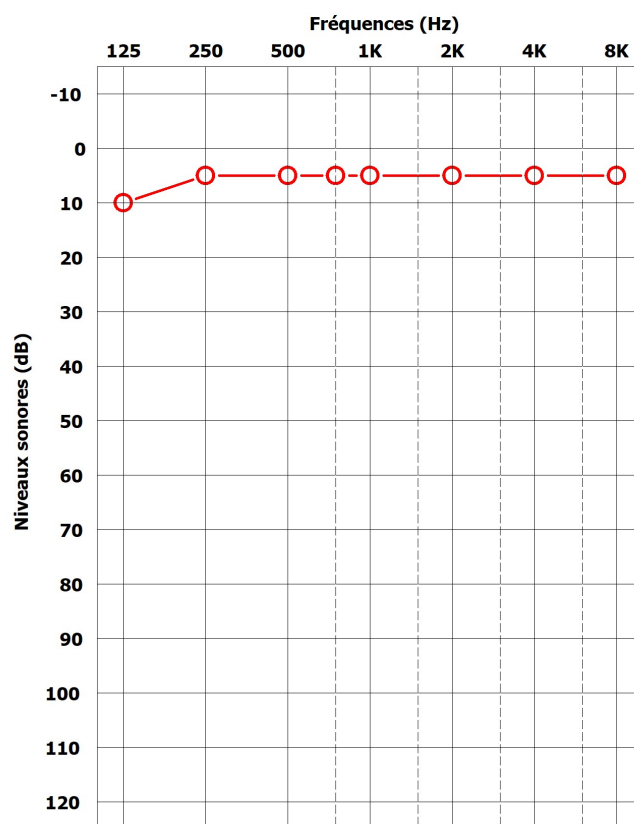

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	10	5	15		5		10		10
CA Droit	10	5	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes