


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 13:19:25
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CONDE SEKOUBA
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CR18
ID	24053113143790476

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

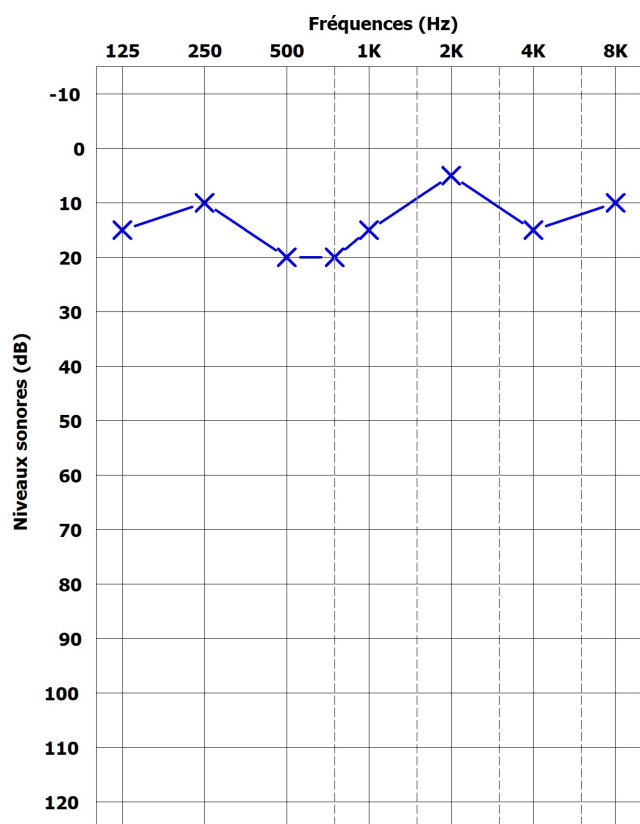

Oreille Gauche

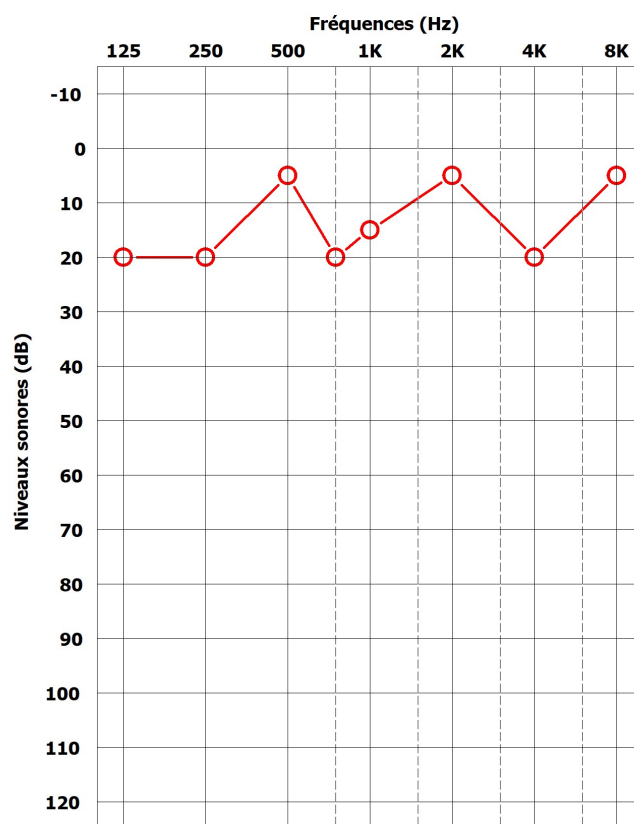

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	20	20	15		5		15		10
CA Droit	20	20	5	20	15		5		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes