


MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 12:06:42
Durée: 6mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE AMADOU
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24050212001309346	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

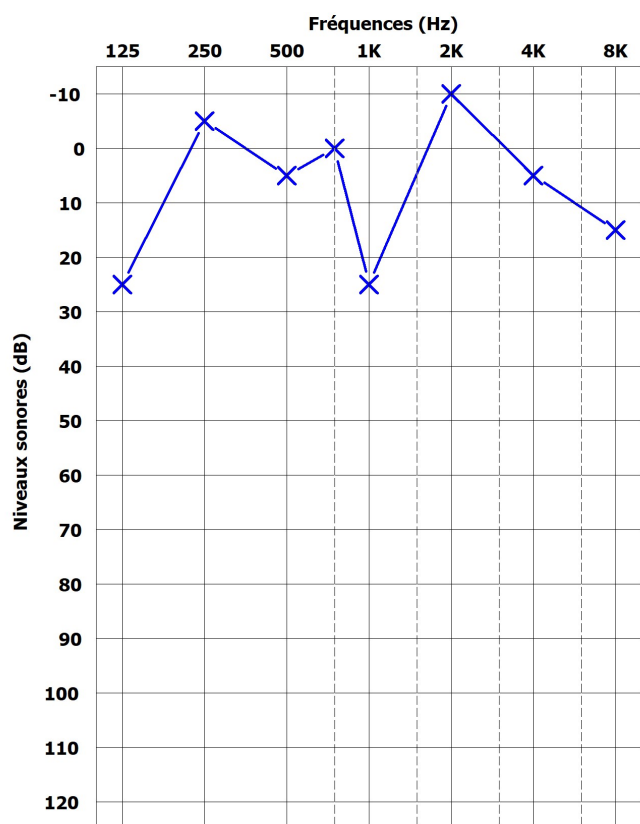

Oreille Gauche

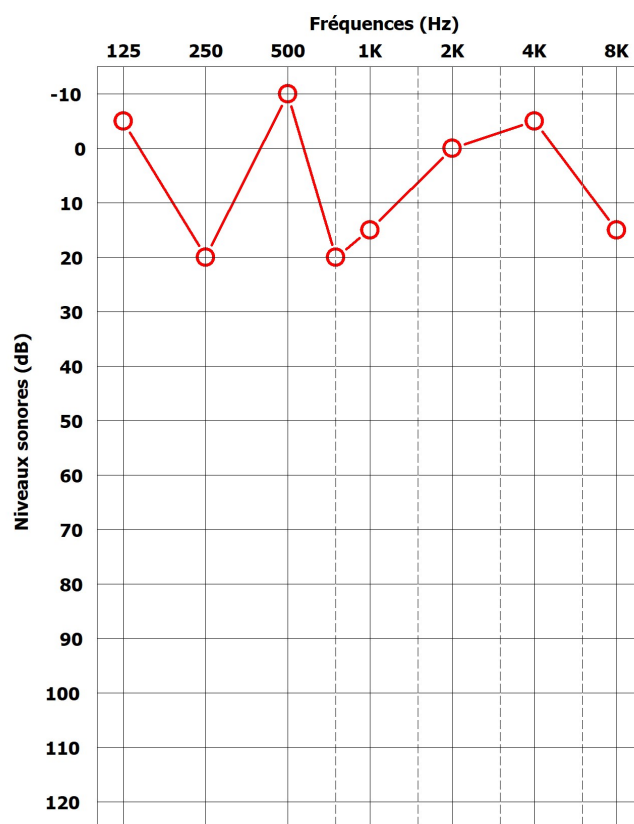

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	-5	5	0	25		-10		5		15
CA Droit	-5	20	-10	20	15		0		-5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes