


MEDVIE


Date du test: 25/05/2024 10:11:14
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		CAMARA FASSOU
Date de naissance	01/01/2003	
Age	21	
Société	CR18	
ID	24052510080763400	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

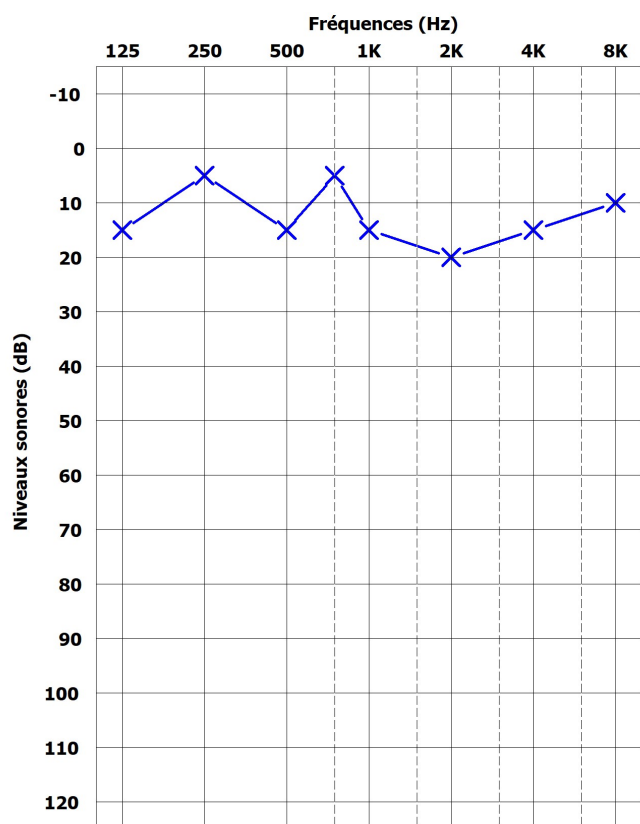

Oreille Gauche

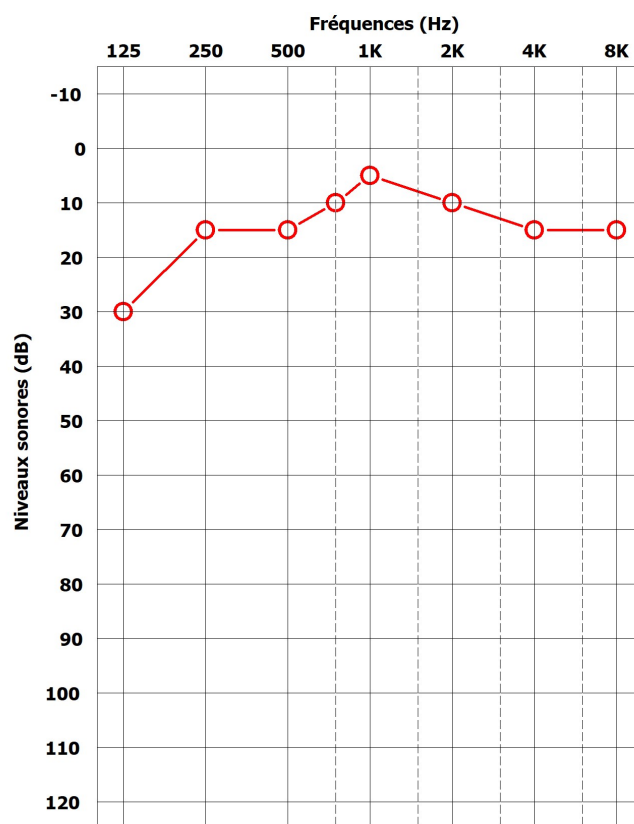

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	15	5	15		20		15		10
CA Droit	30	15	15	10	5		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes