


MEDVIE


Date du test: 03/06/2024 19:30:23
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		KEÏTA FODE
Date de naissance	01/01/1980	
Age	44	
Société	CR18	
ID	24060319261790189	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

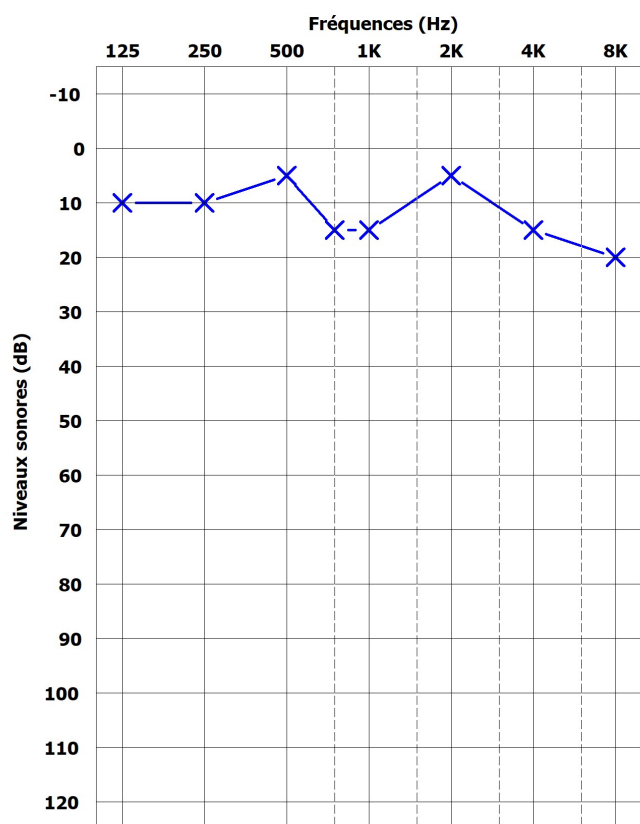

Oreille Gauche

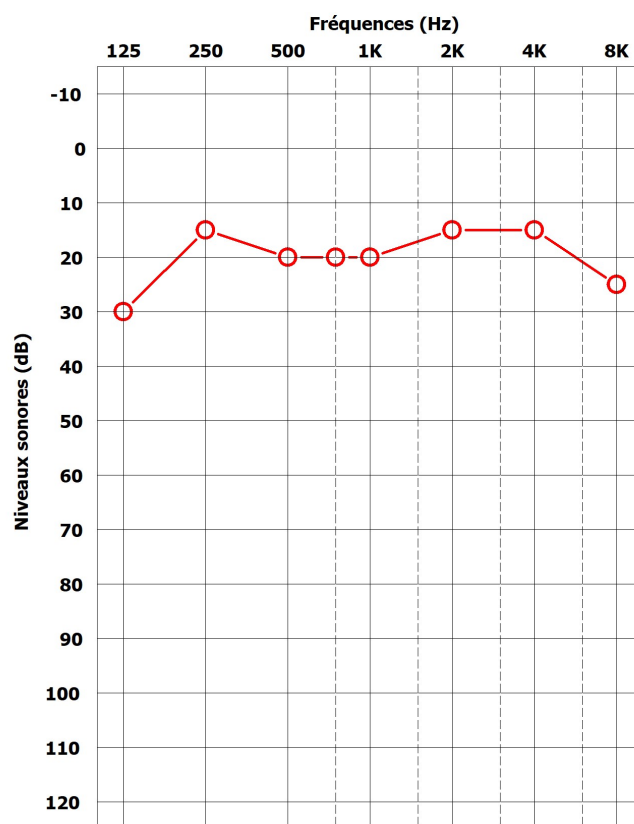

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	5	15	15		5		15		20
CA Droit	30	15	20	20	20		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes