


MEDVIE


Date du test: 03/04/2025 14:16:14
Durée: 4mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHANG Yankun	
Date de naissance	10/10/1988
Age	36
Société	CR18
ID	25040314140333868

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

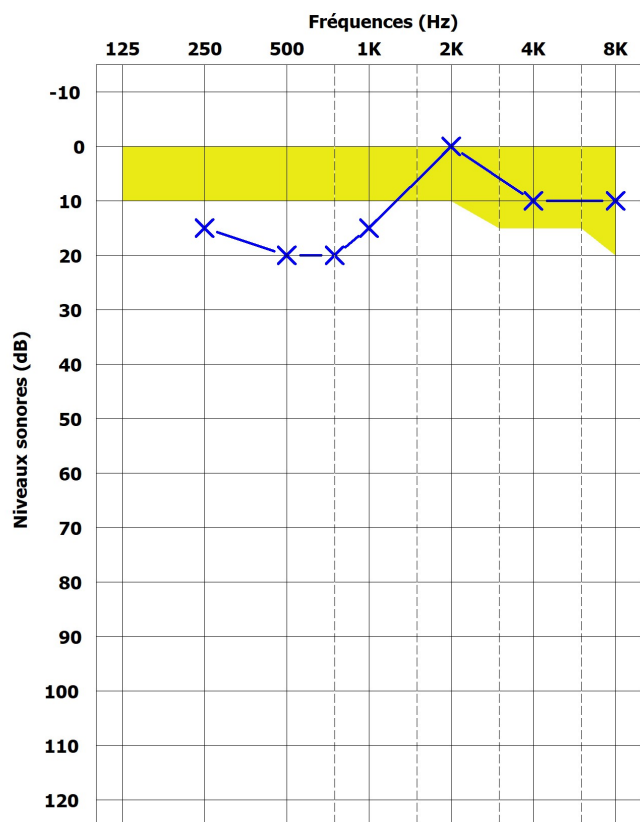

Oreille Gauche

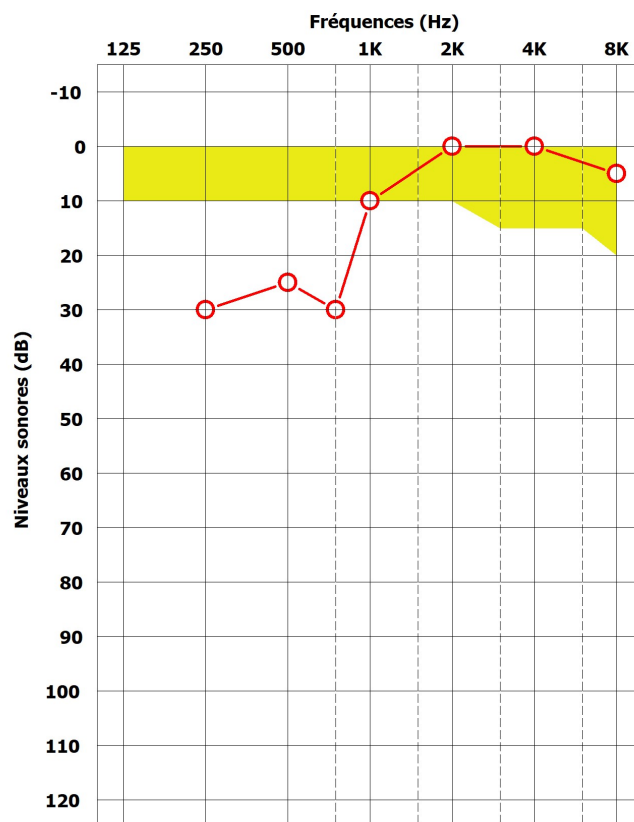

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	15		0		10		10
CA Droit		30	25	30	10		0		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes