


MEDVIE


Date du test: 14/04/2025 12:10:12
Durée: 5mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
WANG LILONG	
Date de naissance	13/05/1969
Age	55
Société	CR18
ID	25041412083313125

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

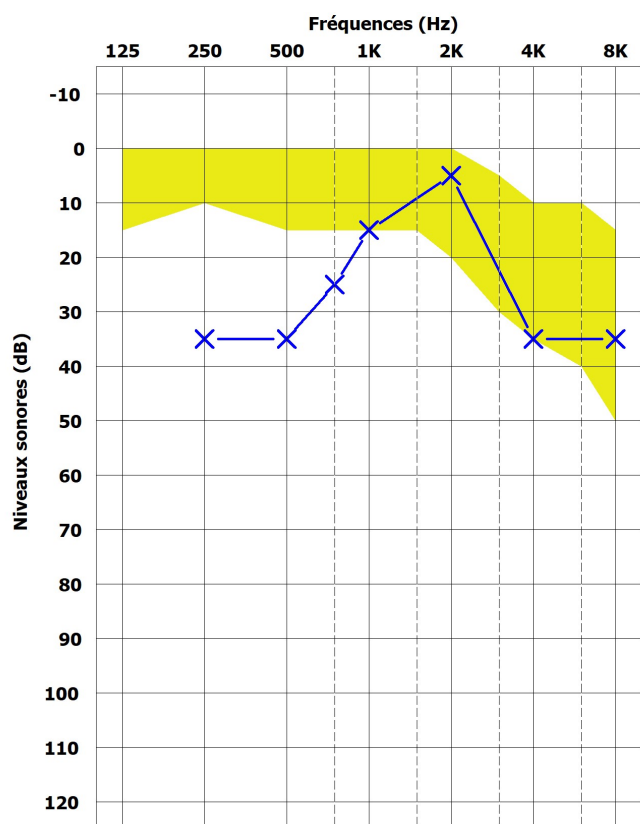

Oreille Gauche

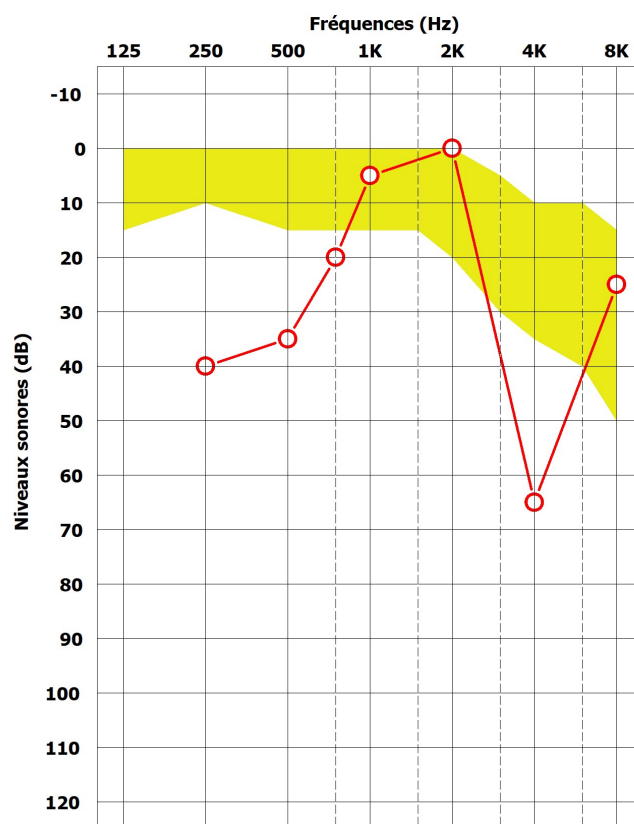

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	25	15		5		35		35
CA Droit		40	35	20	5		0		65		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes