


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 15:32:15
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
KONATE MOHAMED	
Date de naissance	06/01/1982
Age	42
Société	CR18
ID	24053115312157927

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

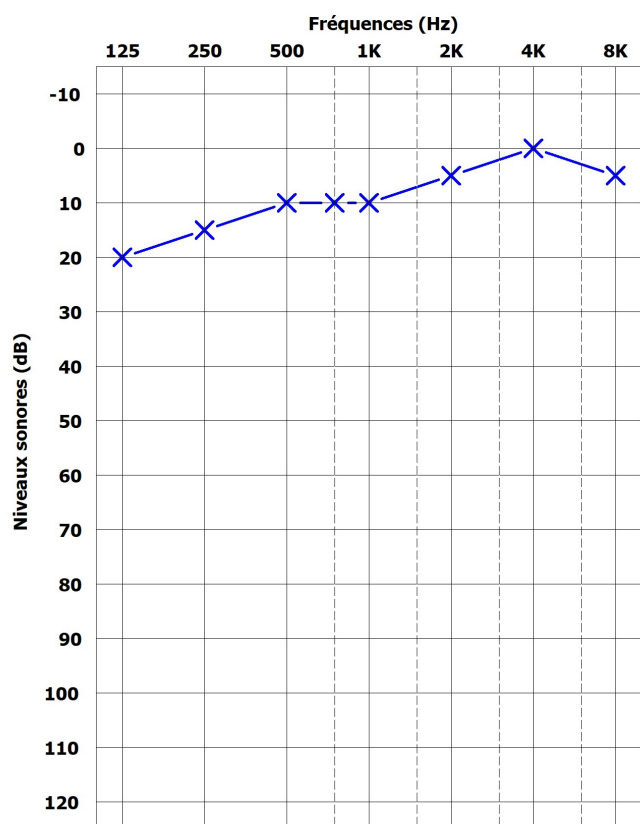

Oreille Gauche

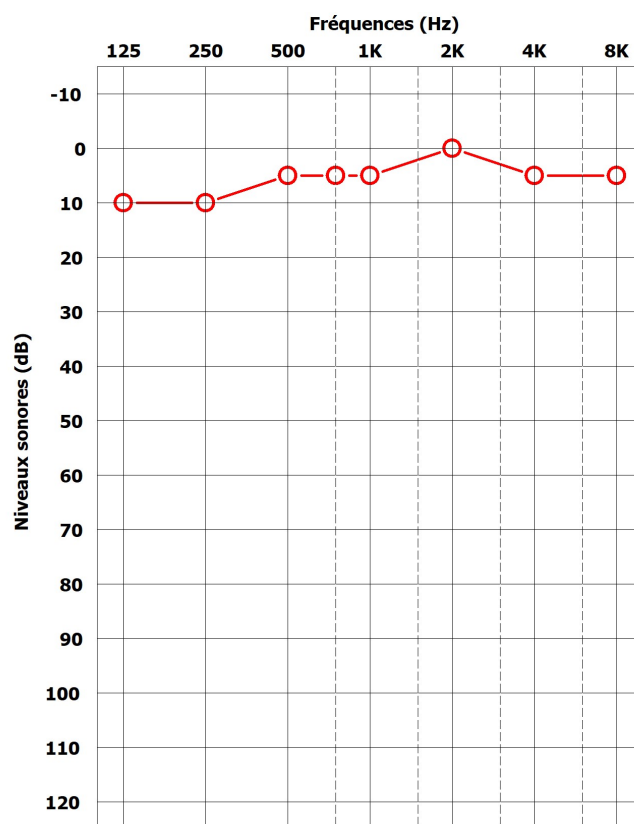

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	10	10		5		0		5
CA Droit	10	10	5	5	5		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes