


MEDVIE


Date du test: 08/08/2025 12:20:45
Durée: 3mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SOUMAILA
Date de naissance	01/01/1985	
Age	40	
Société		
ID	25080812171118203	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

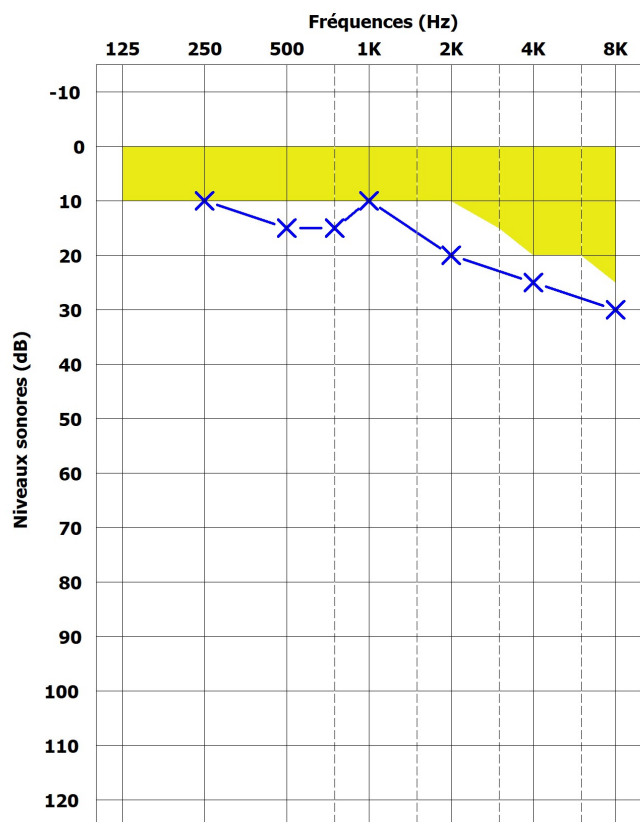

Oreille Gauche

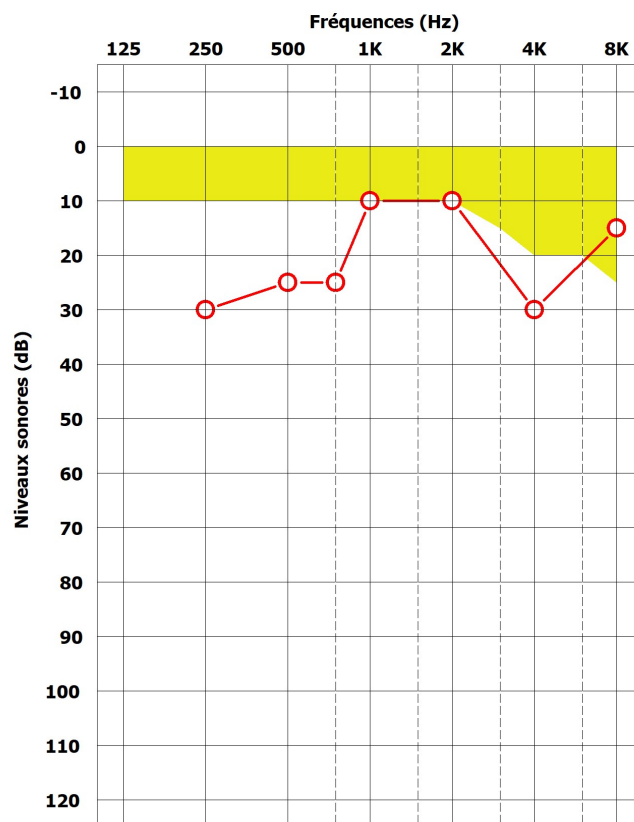

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	10		20		25		30
CA Droit		30	25	25	10		10		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes