

Données Patient

SQUARE OUSMANE

Date de naissance 01/01/2000
Age 25
Société CR18
ID 25010313250156778


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 03/01/2025 13:27:14

Durée: 4mn 14s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

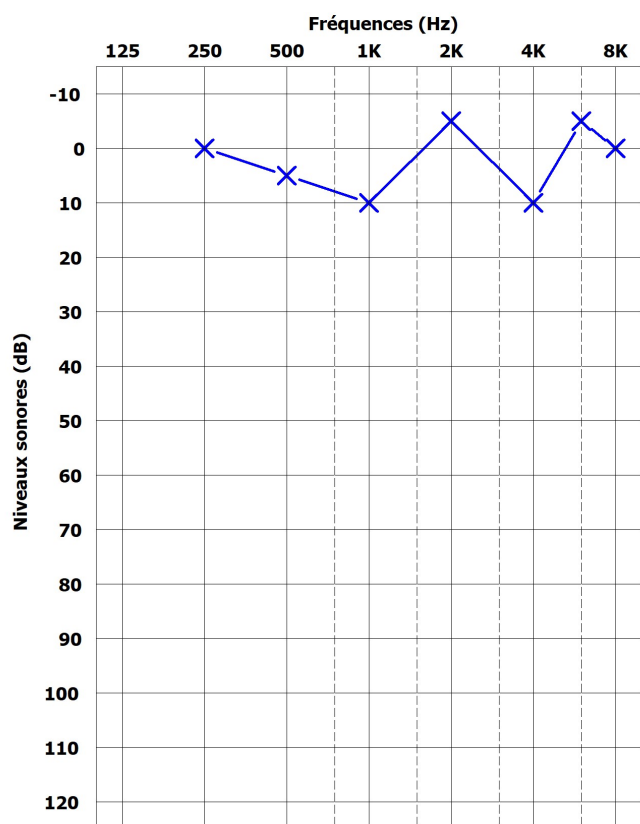

Oreille Gauche

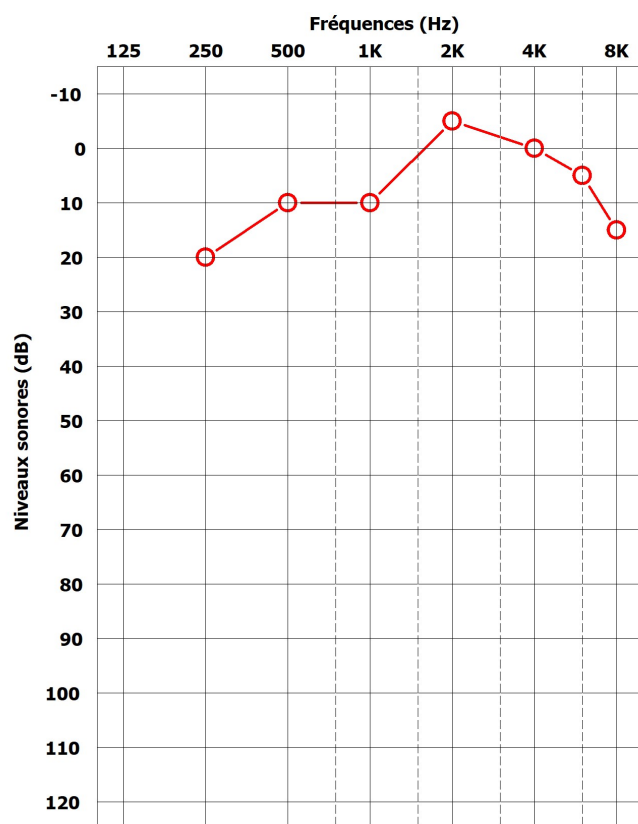

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5		10		-5		10	-5	0
CA Droit		20	10		10		-5		0	5	15

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes