


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:16:18
Durée: 4mn 14s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZHANG HONG CHANG
Date de naissance	02/03/1972
Age	53
Société	CR18
ID	25031812142725633

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

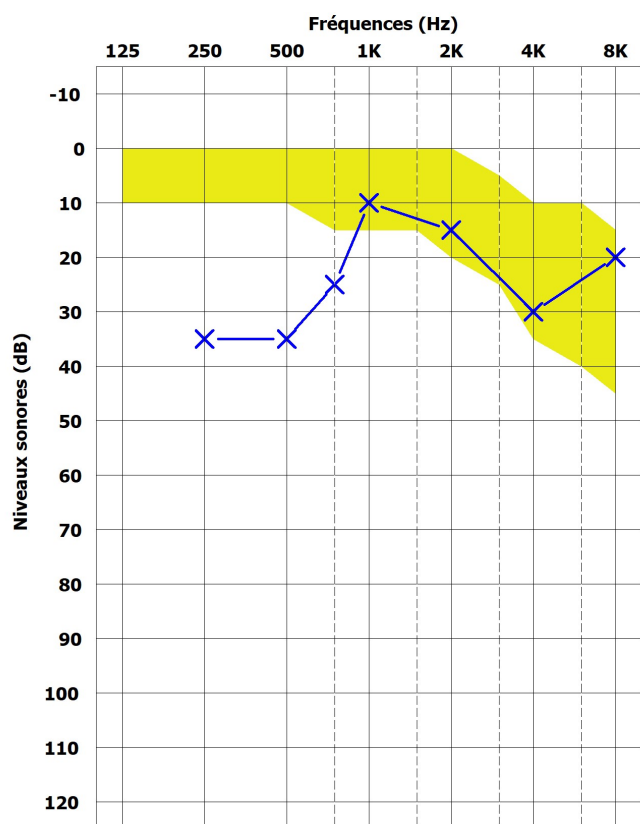

Oreille Gauche

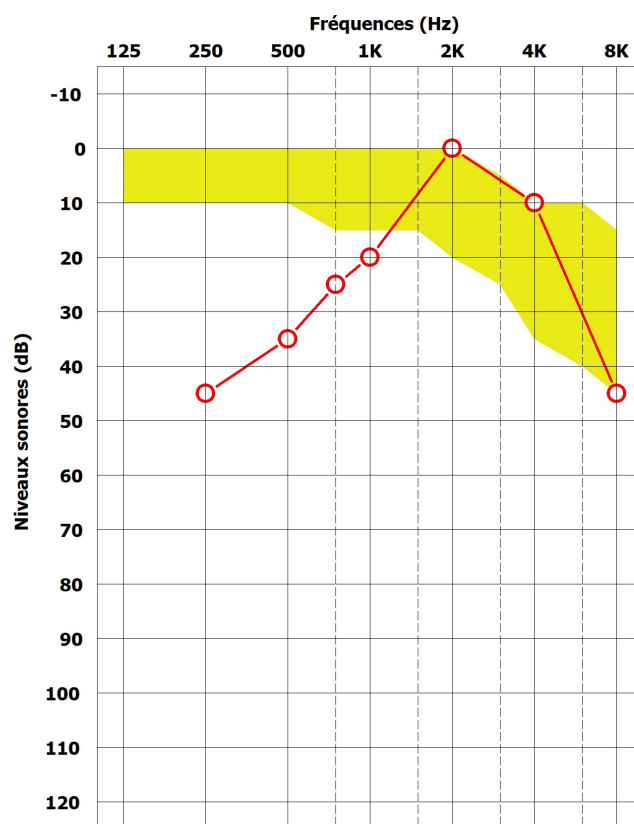

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	25	10		15		30		20
CA Droit		45	35	25	20		0		10		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes