

MEDVIE

Date du test: 02/06/2024 10:54:19


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient	SIDIBE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24060210502039127

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

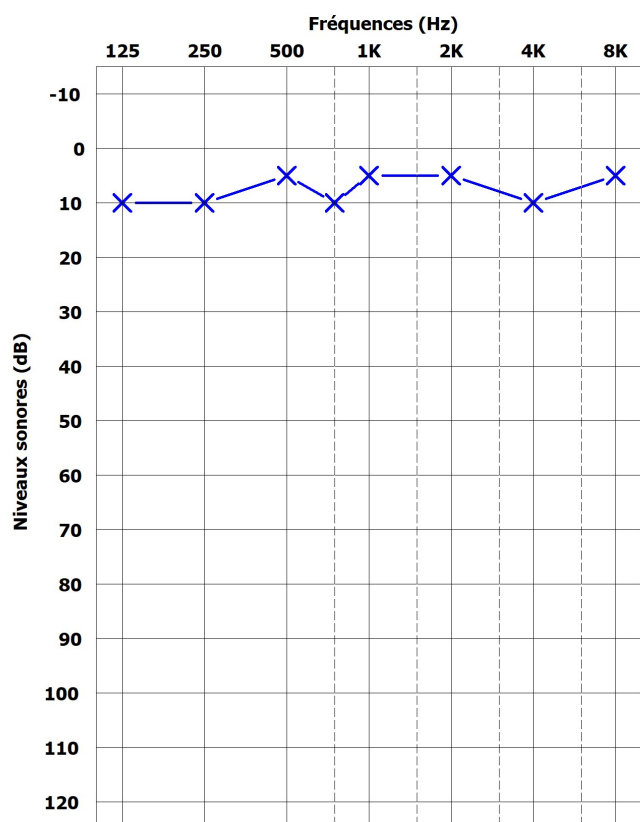

Oreille Gauche

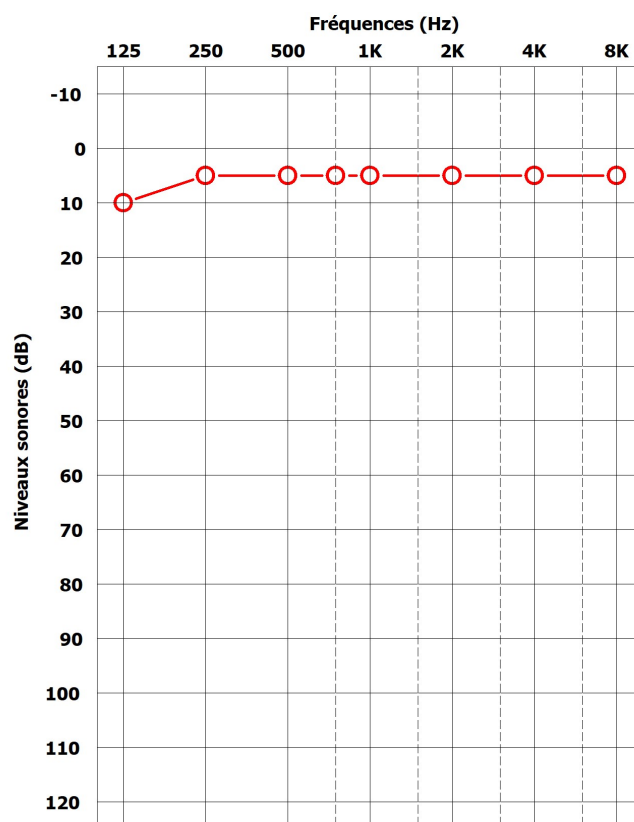

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	5	10	5		5		10		5
CA Droit	10	5	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes