

MEDVIE

Date du test: 12/04/2024 12:05:23

Durée: 10mn 01s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **DIALLO ALPHA OUMAR**

Date de naissance 01/01/1998

Age 26

Société CR18


ID 24041211593242977

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

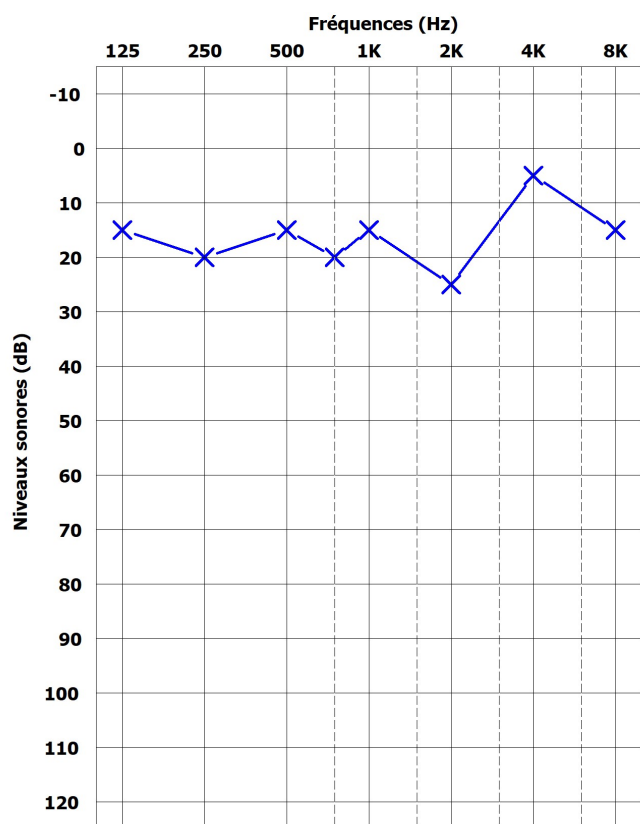

Oreille Gauche

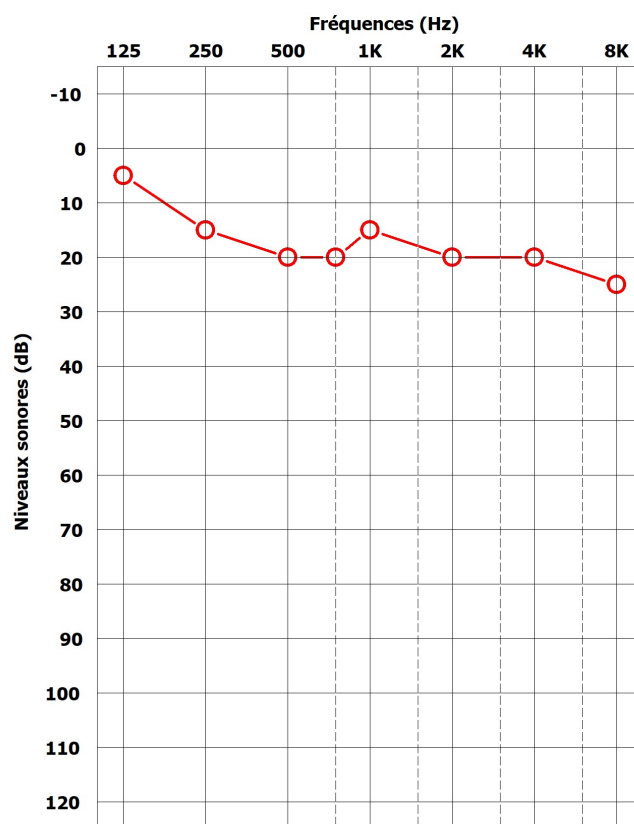

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	15	20	15		25		5		15
CA Droit	5	15	20	20	15		20		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes