


MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 15:28:20
Durée: 2mn 59s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
CHERIF N'FALY	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24051015250286105

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

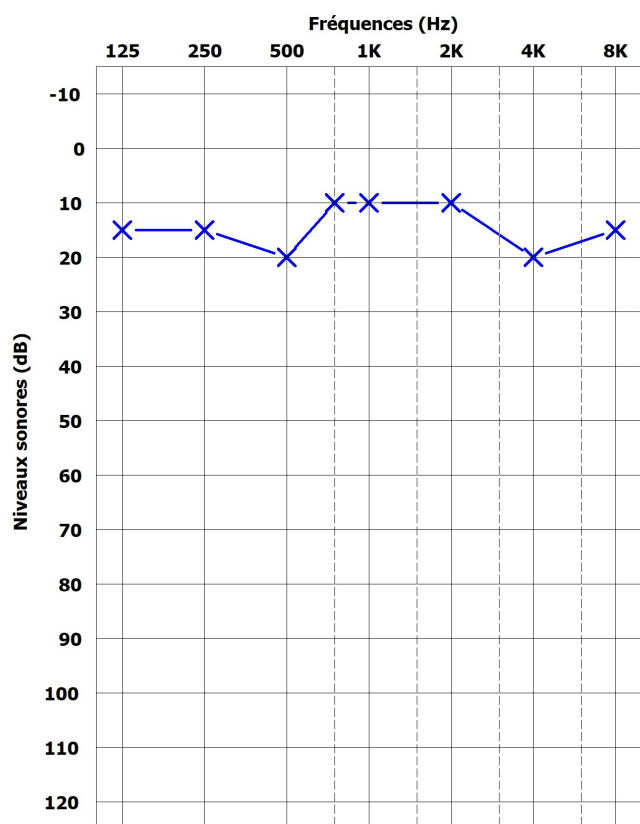

Oreille Gauche

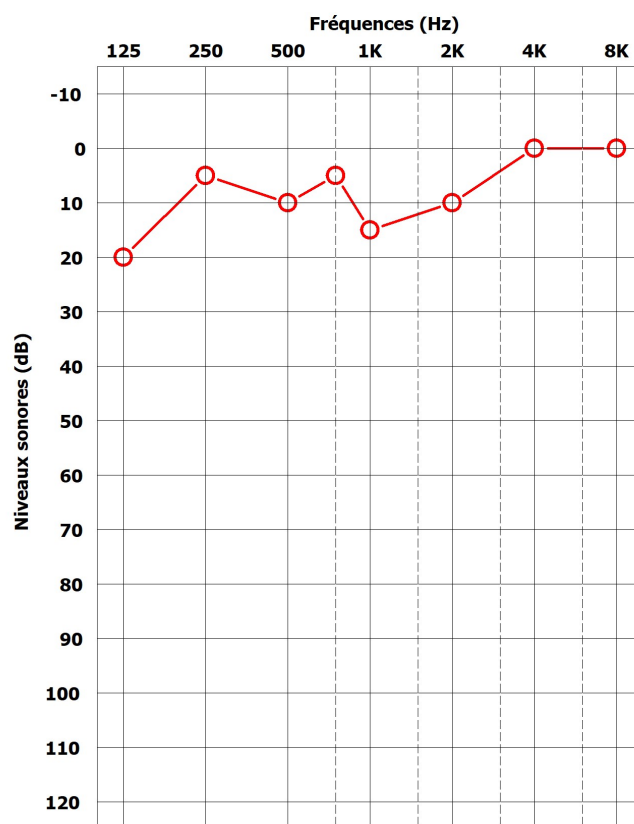

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	20	10	10		10		20		15
CA Droit	20	5	10	5	15		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes