


MEDVIE


Date du test: 14/05/2024 11:26:39  
Durée: -- mn -- s  
Type test Manuel  
Continu

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KEÏTA ANSOUMANE   |                   |
| Date de naissance | 01/09/1994        |
| Age               | 29                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24051411220675460 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

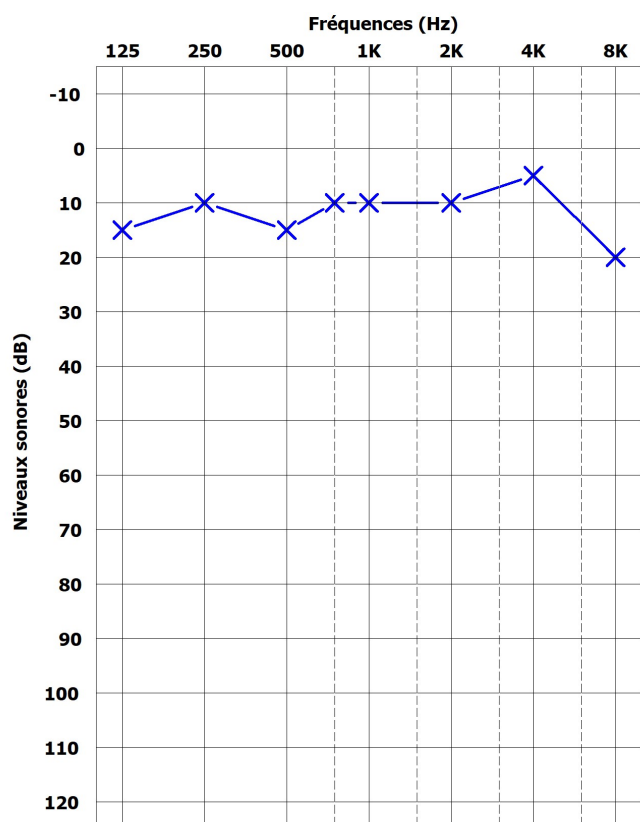

Oreille Gauche

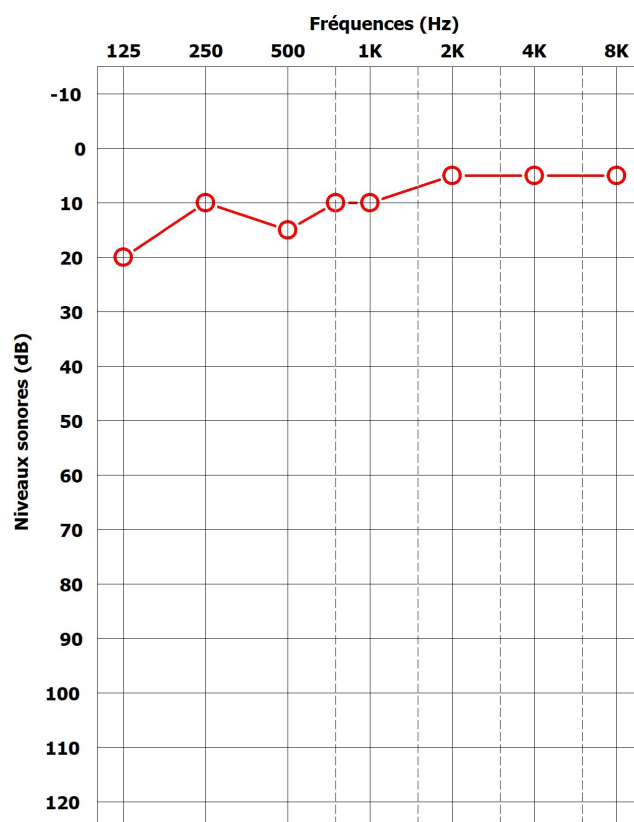

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 15  | 10  | 15  | 10  | 10 |     | 10 |    | 5  |    | 20 |
| CA Droit  | 20  | 10  | 15  | 10  | 10 |     | 5  |    | 5  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 10,0 dB | --- |
| CA Droit        | 8,8 dB  | --- |

Notes