


MEDVIE


Date du test: 22/07/2025 15:29:06  
Durée: 5mn 45s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SOUMAORO LAYE     |                   |
| Date de naissance | 01/01/2000        |
| Age               | 25                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25072215262856398 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

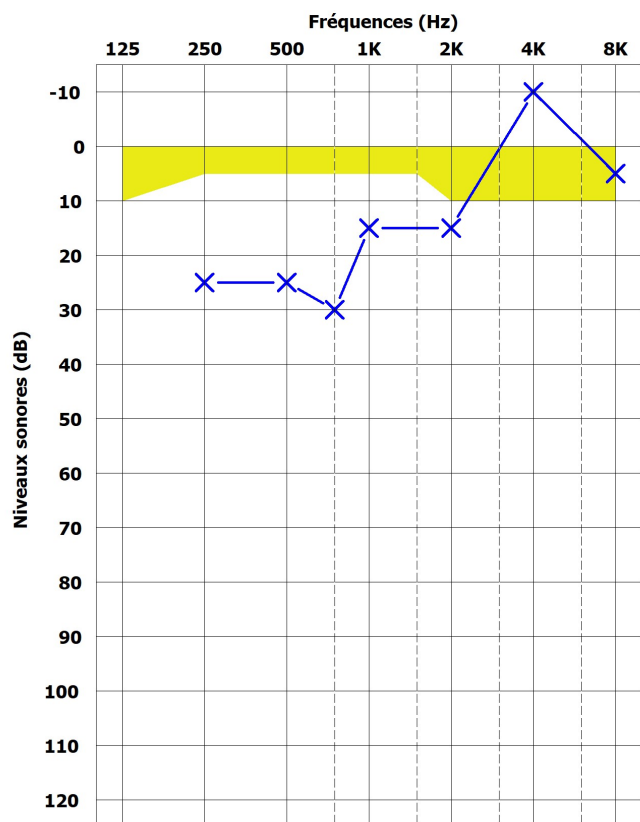

Oreille Gauche

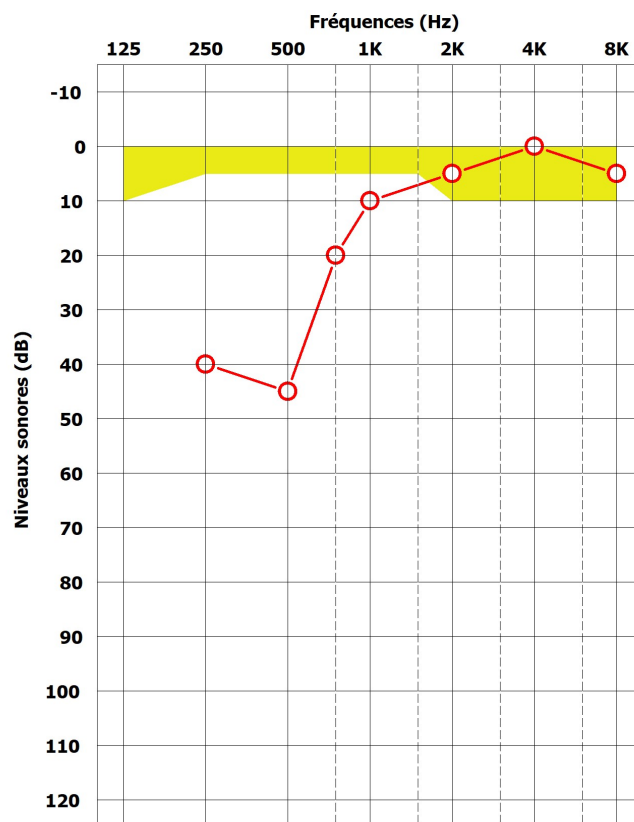

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k  | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 30  | 15 |     | 15 |    | -10 |    | 5  |
| CA Droit  |     | 40  | 45  | 20  | 10 |     | 5  |    | 0   |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 11,3 dB | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes