


MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 14:58:44

Durée: 12mn 23s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

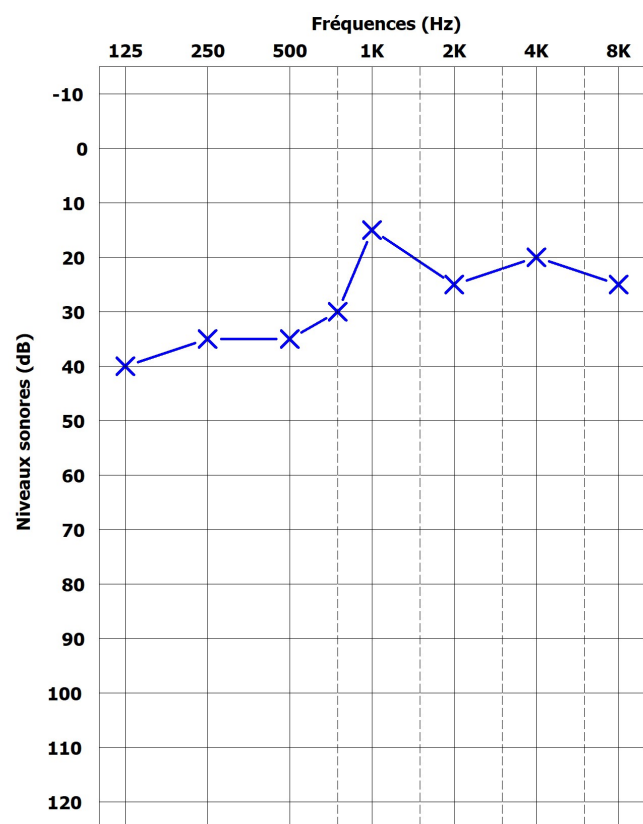

Oreille Gauche

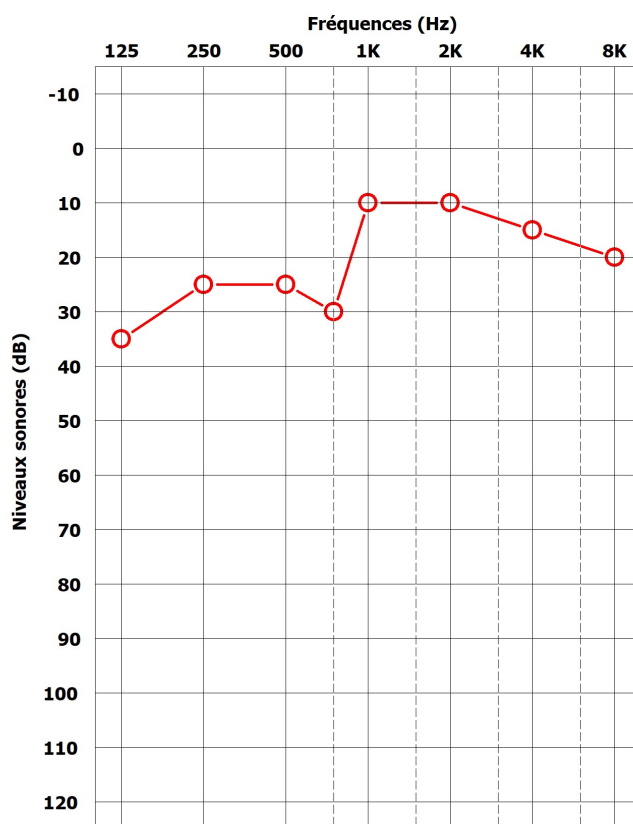

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	35	35	30	15		25		20		25
CA Droit	35	25	25	30	10		10		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SEKOU
Date de naissance	05/07/1984
Age	39
Société	CR18
ID	24040914552508529

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021