

MEDVIE


Date du test: 16/08/2025 13:10:59

Durée: 4mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZHANG XIAOQING
Date de naissance	12/06/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25081613075106571

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

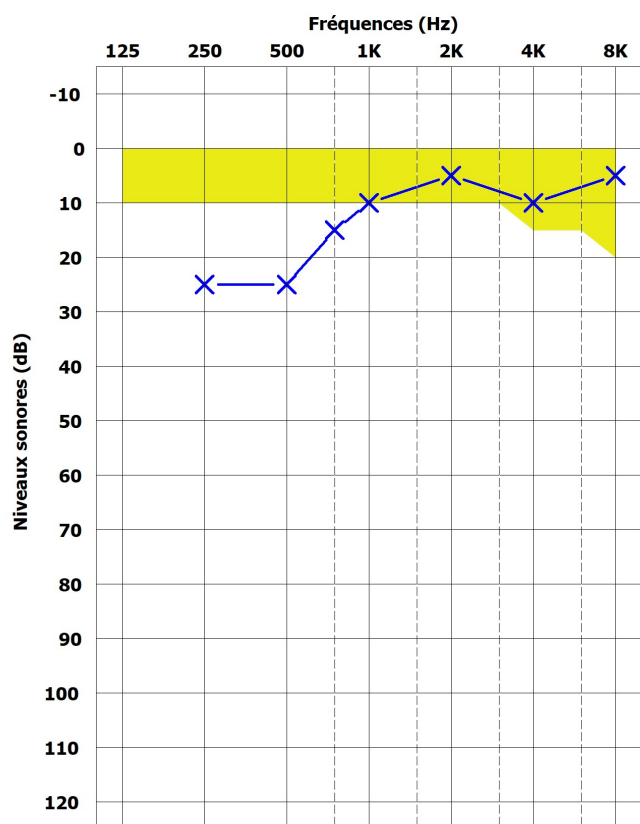

Oreille Gauche

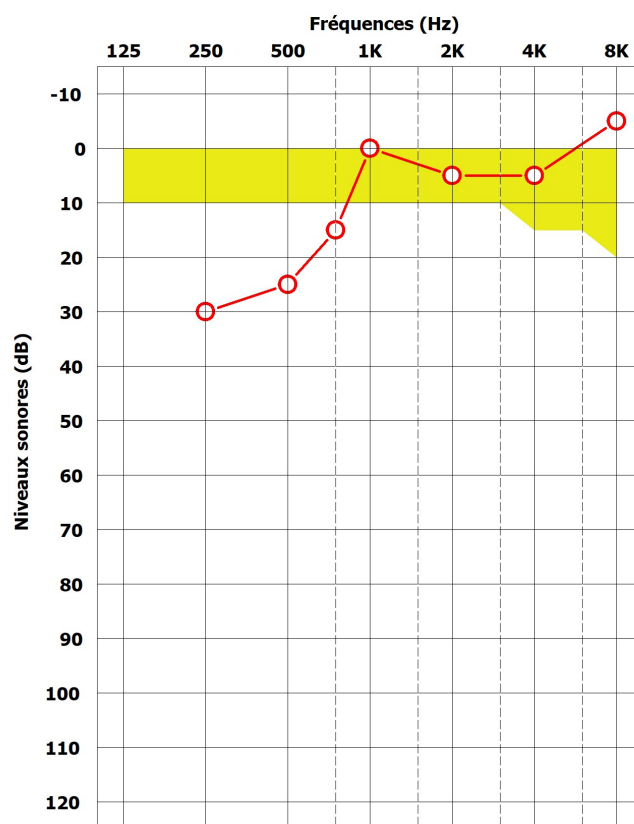

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	10		5		10		5
CA Droit		30	25	15	0		5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes