

MEDVIE

Date du test: 25/05/2024 13:28:38

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

TRAORE LANCINET

Date de naissance 01/01/2004

Age 20

Société CR18


ID 24052513234600174

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

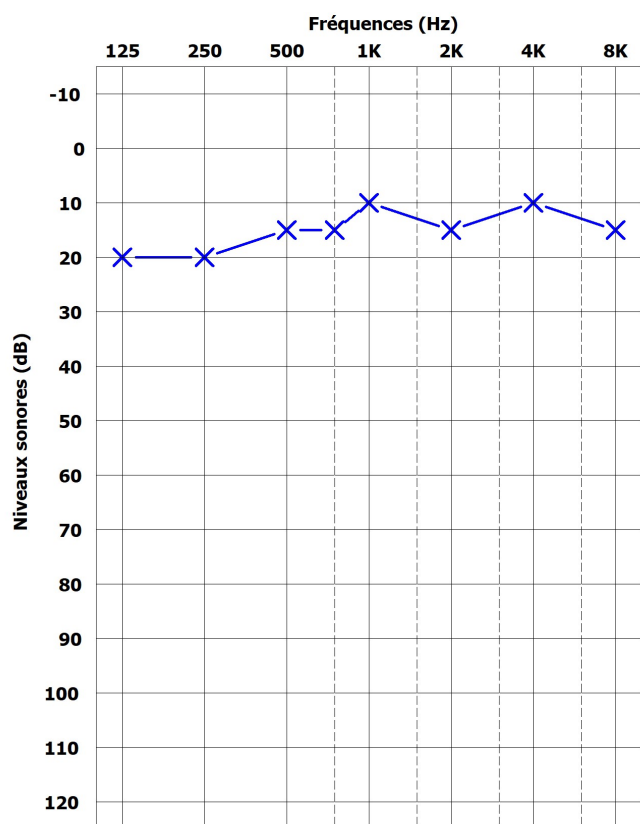

Oreille Gauche

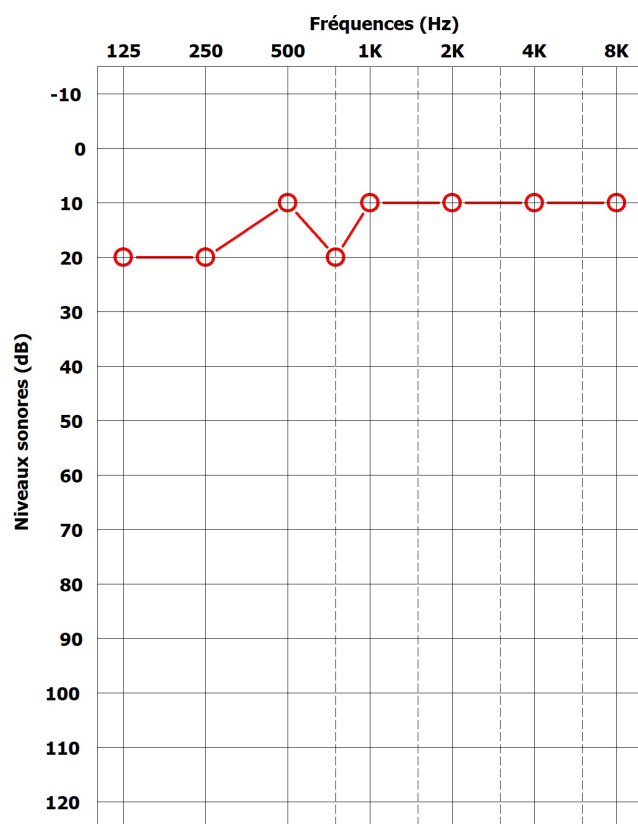

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	15	15	10		15		10		15
CA Droit	20	20	10	20	10		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes