

MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 12:05:03

Durée: 6mn 12s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE NAGOUMA
Date de naissance	01/12/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24121612025783429	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

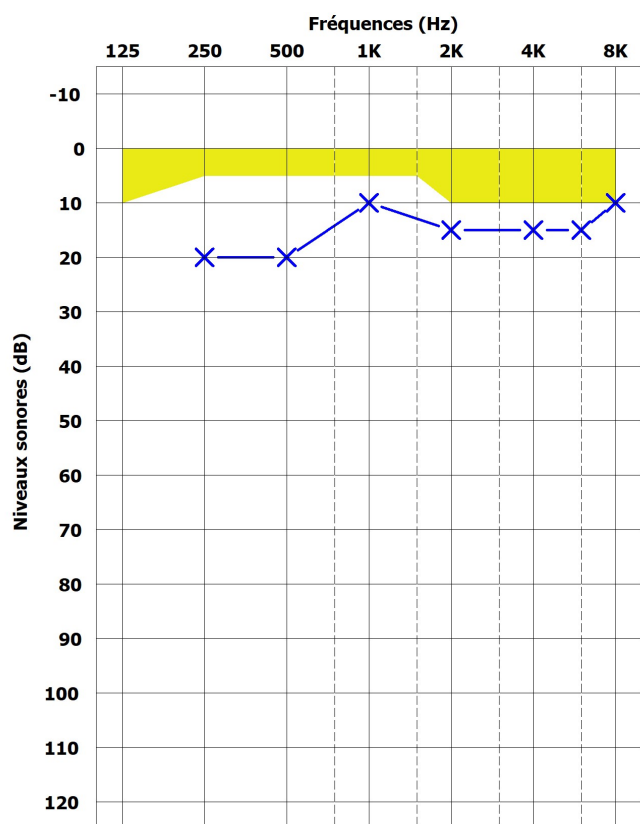

Oreille Gauche

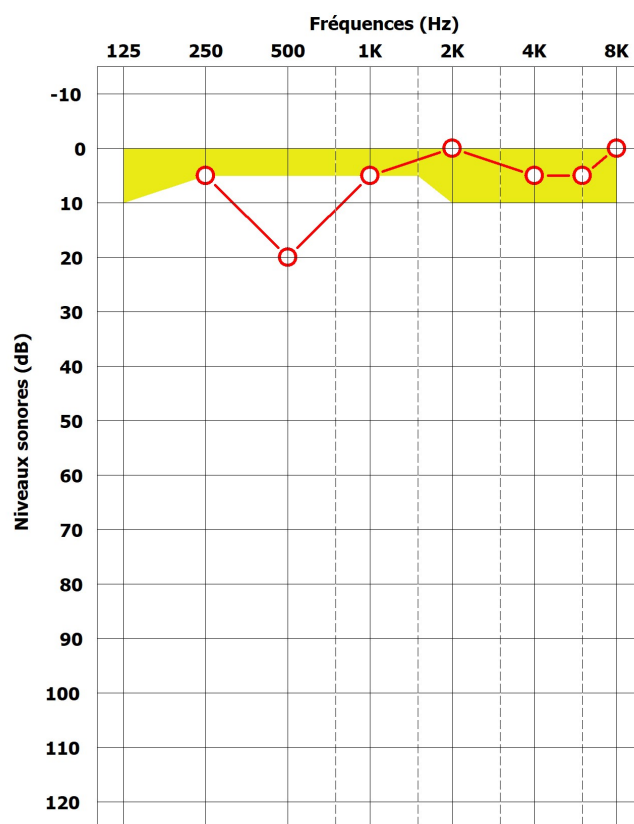

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		10		15		15	15	10
CA Droit		5	20		5		0		5	5	0

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes