


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 15:48:41
Durée: 5mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
Date de naissance	05/10/1992
Age	31
Société	CR18
ID	24093013432979113

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

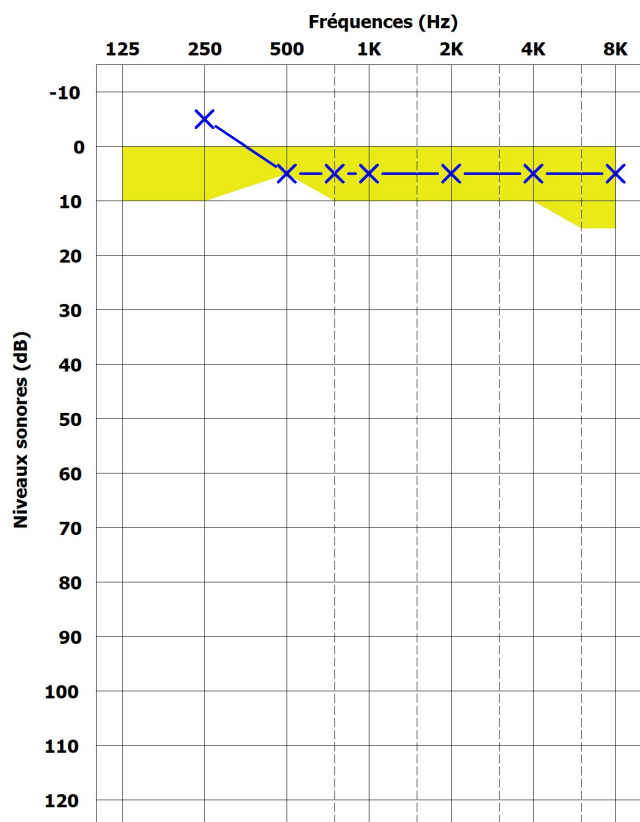

Oreille Gauche

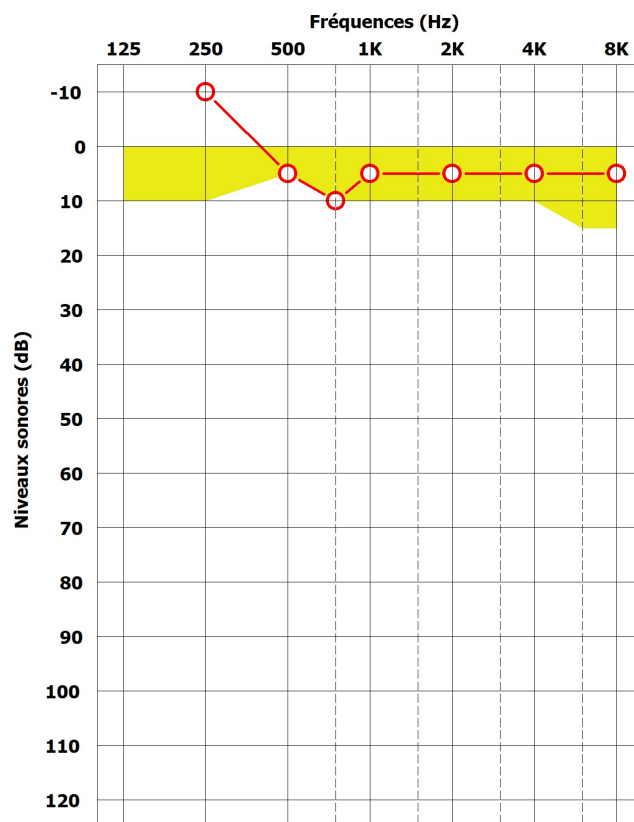

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	5	5		5		5		5
CA Droit		-10	5	10	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes