


MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 13:27:57
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KONATE ALY
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24050213213955911

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

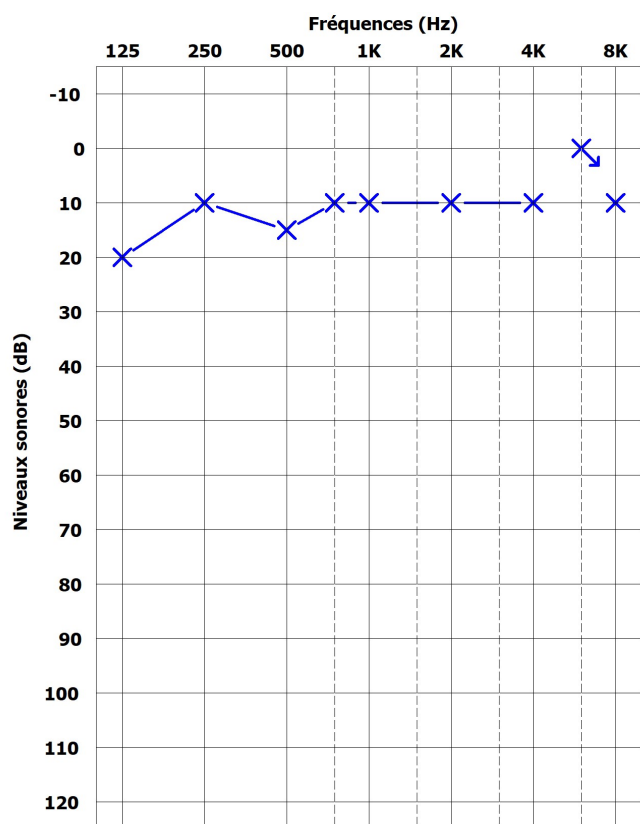

Oreille Gauche

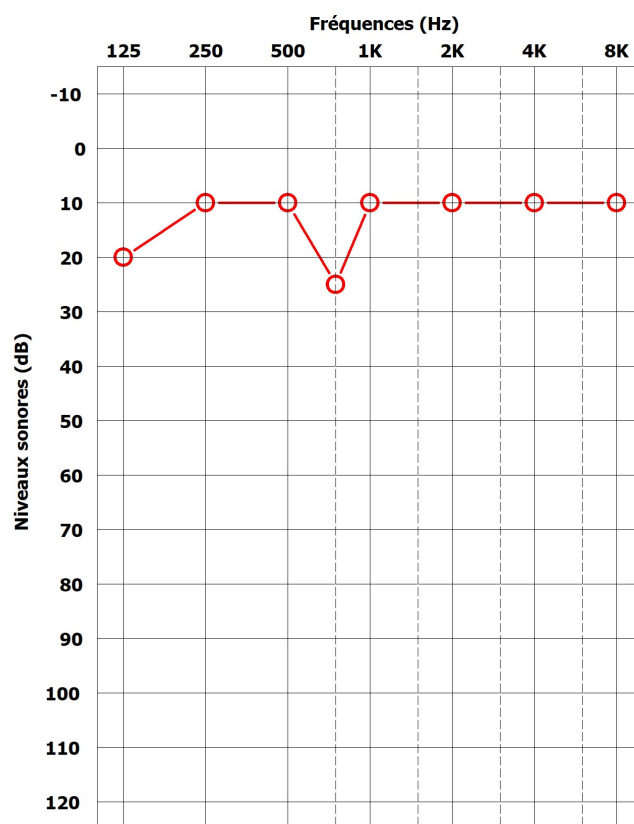

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	15	10	10		10		10	(0)	10
CA Droit	20	10	10	25	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes