

MEDVIE

Date du test: 09/07/2025 15:55:42
Durée: 5mn 48s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

PEI SHUNQING


Date de naissance: 14/10/1968
Age: 56
Société: CR18
ID: 25070915532161940

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

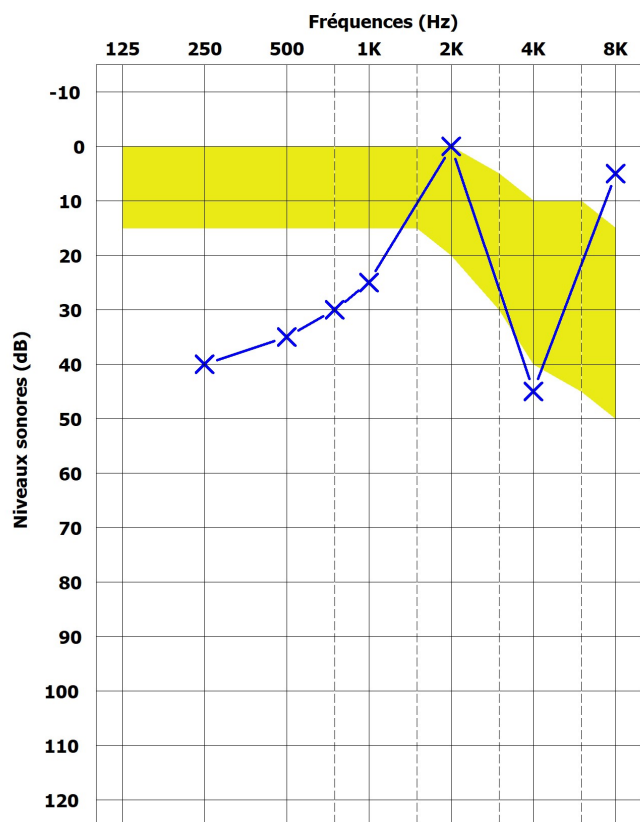

Oreille Gauche

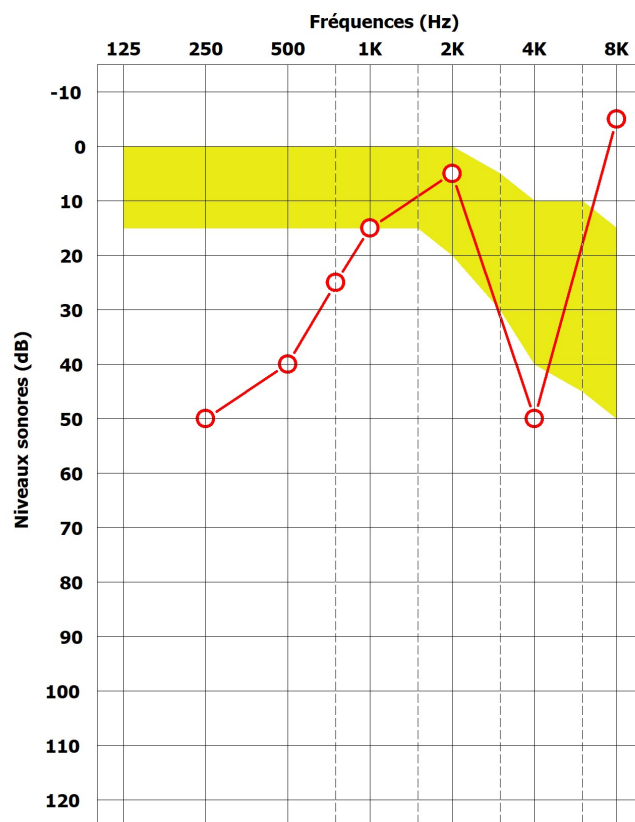

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	35	30	25		0		45		5
CA Droit		50	40	25	15		5		50		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes