

MEDVIE

Date du test: 20/03/2025 12:43:22

Durée: 4mn 46s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **CHEN SHENGLANG**

Date de naissance 06/02/2000

Age 25

Société CR18


ID 25032012414176846

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

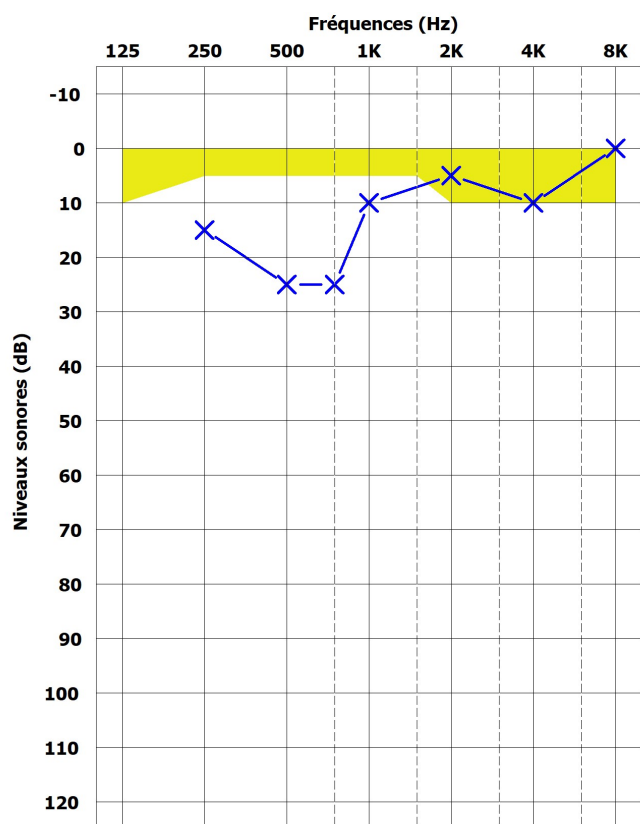

Oreille Gauche

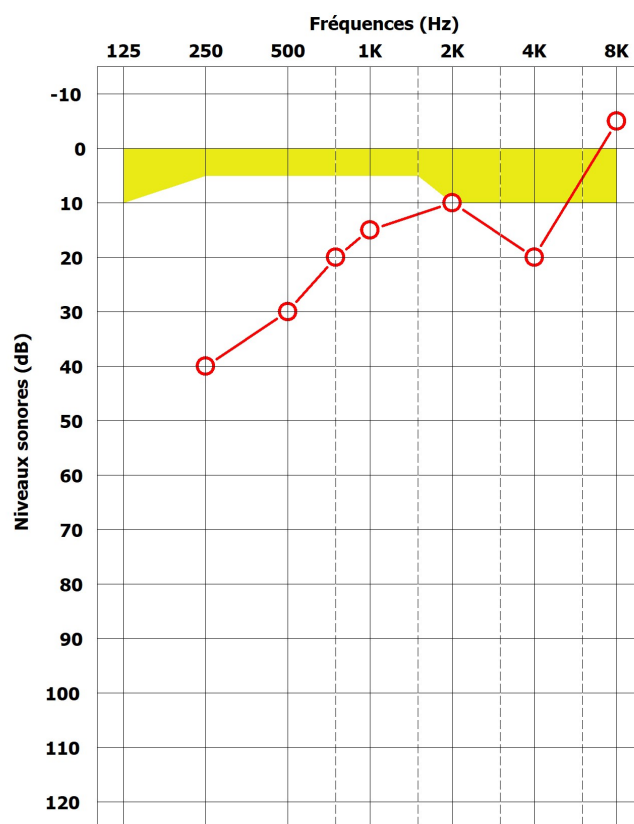

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	10		5		10		0
CA Droit		40	30	20	15		10		20		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes