

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 17:11:23

Durée: 7mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SOUMAORO VIEUX
Date de naissance	01/01/1998	
Age	26	
Société	CR18	
ID	24041517092203611	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

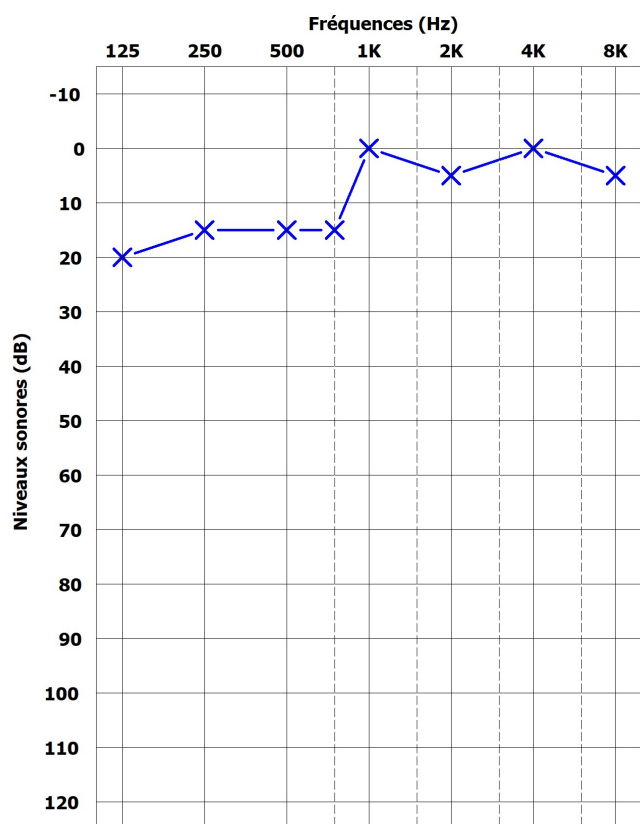

Oreille Gauche

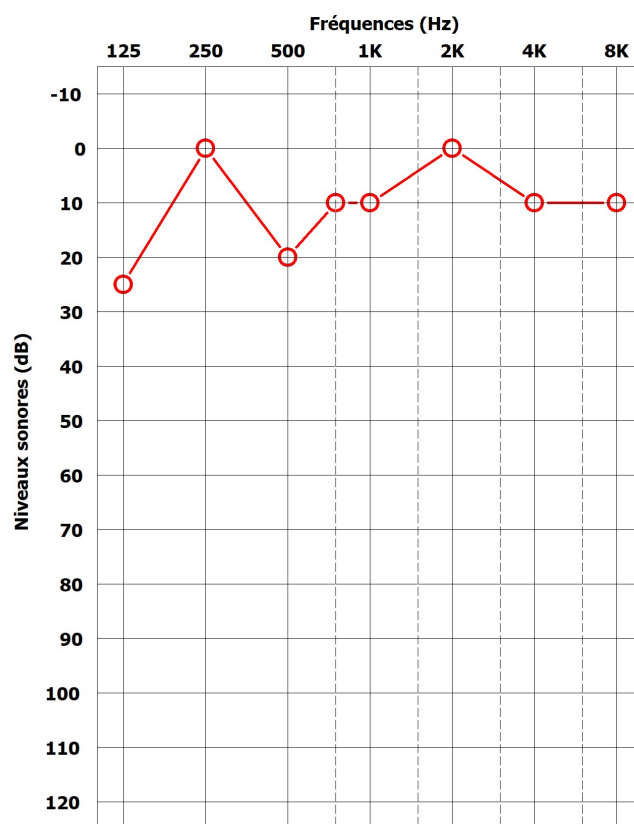

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	15	0		5		0		5
CA Droit	25	0	20	10	10		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes