



MEDVIE

Date du test: 07/03/2025 13:01:07
Durée: 4mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

BAMBA KARAMO

Date de naissance

01/01/1997

Age

28

Société

CR18

ID

25030712533318900

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

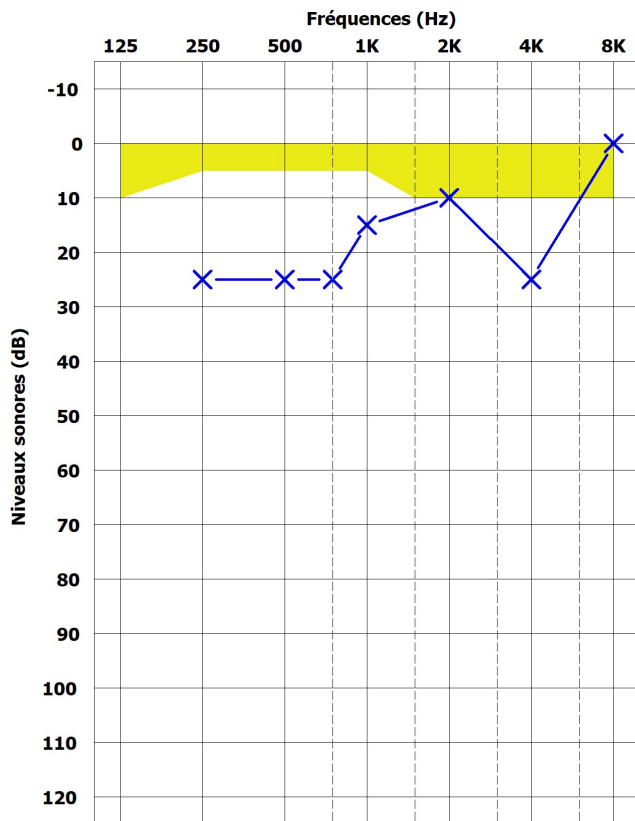

Oreille Gauche

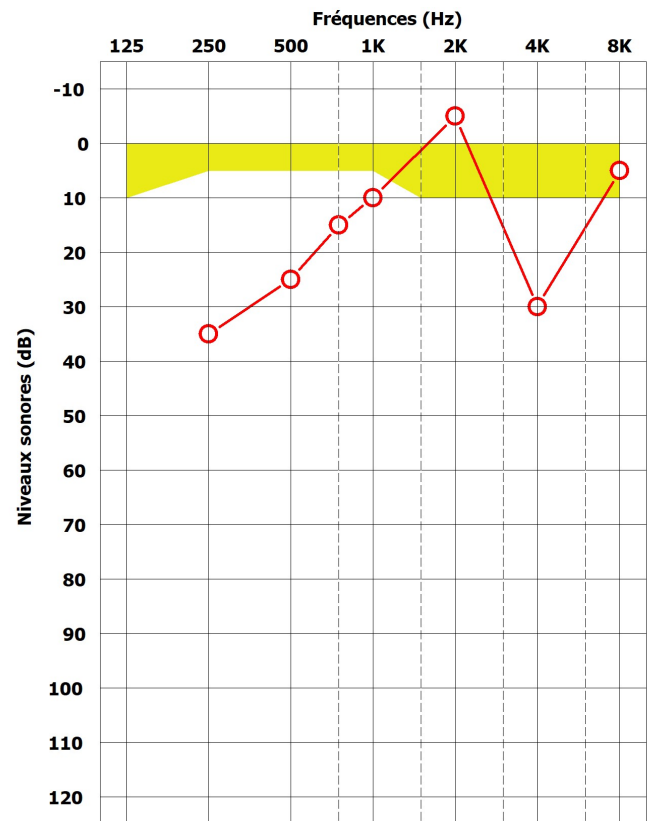

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	15		10		25		0
CA Droit		35	25	15	10		-5		30		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes