


MEDVIE


Date du test: 24/05/2024 15:39:52
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		TRAORE SEKOU
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24052415375826505	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

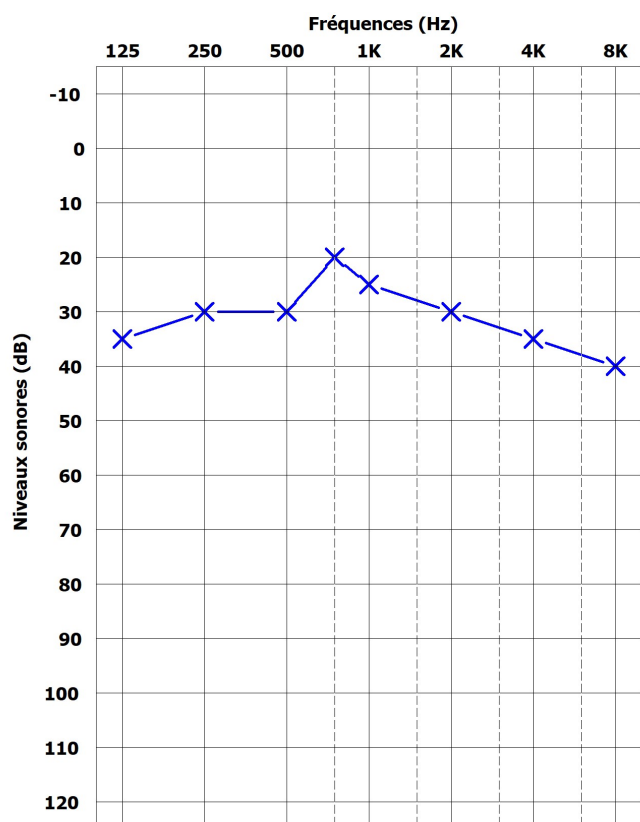

Oreille Gauche

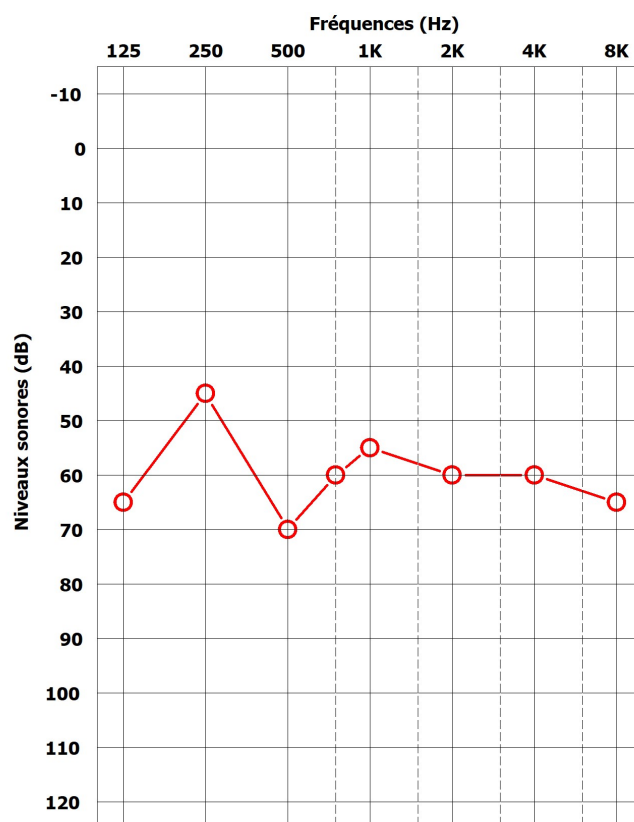

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	30	20	25		30		35		40
CA Droit	65	45	70	60	55		60		60		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	61,3 dB	---

Notes