

MEDVIE

Date du test: 09/04/2025 13:00:29

Durée: 7mn 01s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **ZHANG JIAN ZHONG**

Date de naissance 01/01/1972

Age 53

Société CR18


ID 25040912455186241

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

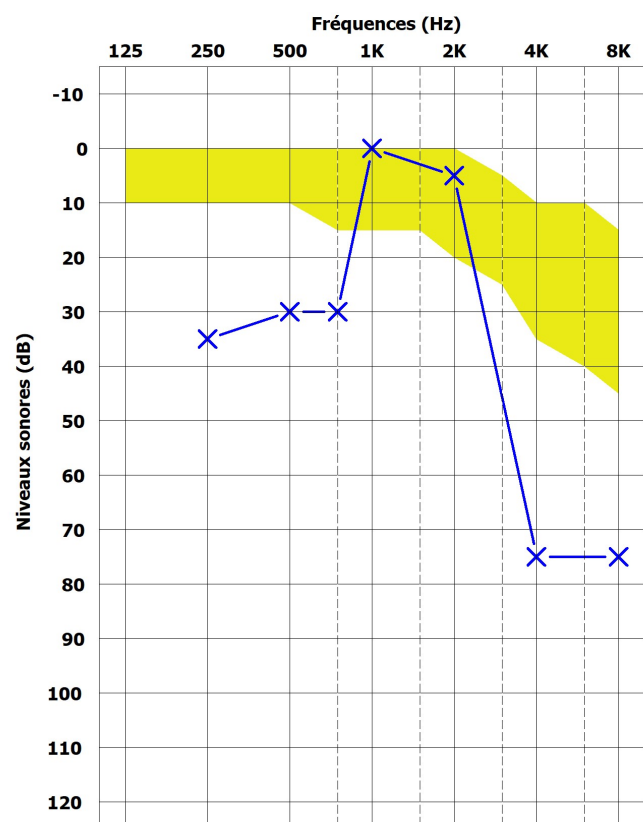

Oreille Gauche

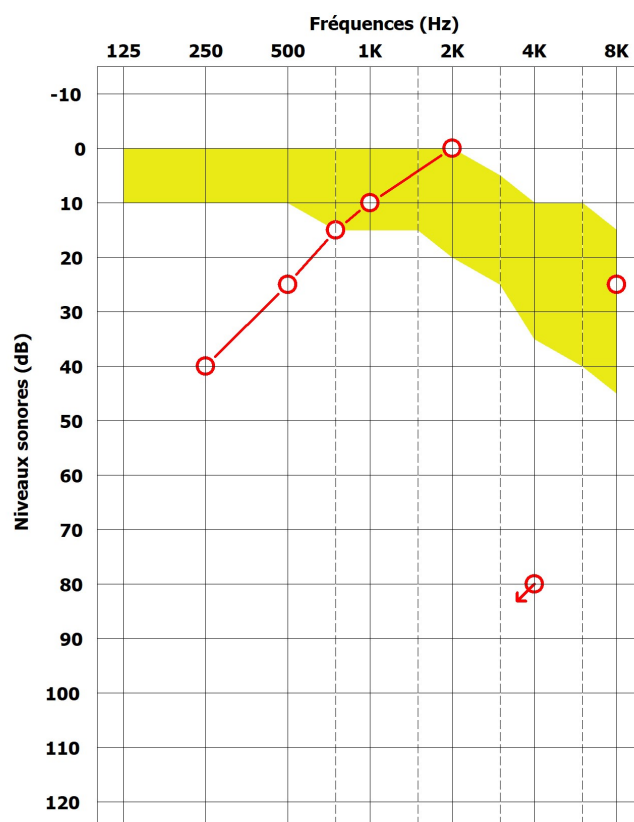

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	30	0		5		75		75
CA Droit		40	25	15	10		0		(80)		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	---	---

Notes