

MEDVIE

Date du test: 20/05/2024 14:56:50


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

Données Patient		CAMARA SEKOU
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	CR18	
ID	24052014524016392	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

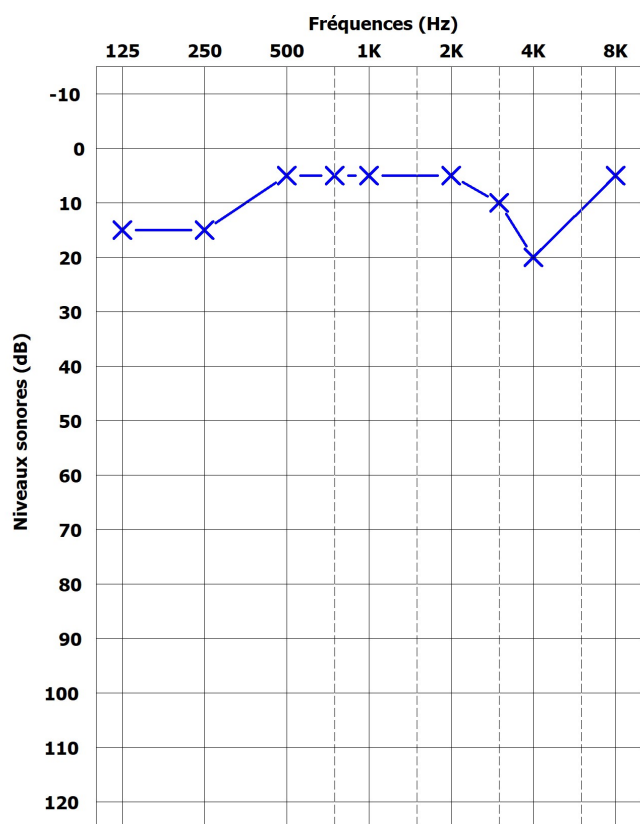

Oreille Gauche

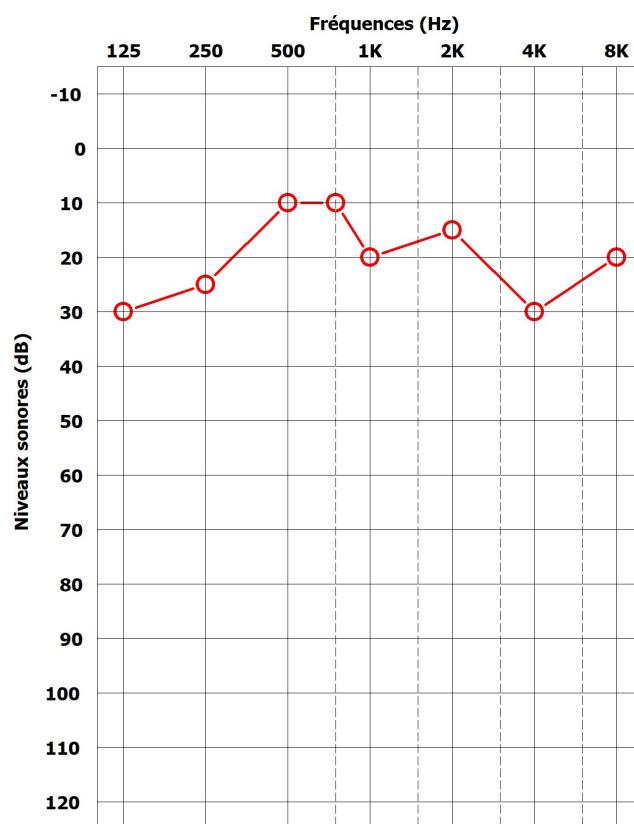

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	5	5	5		5	10	20		5
CA Droit	30	25	10	10	20		15		30		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes