

MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 11:45:25

Durée: 7mn 03s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | FOFANA MAMADY     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 27/01/1980        |
| Age               | 44                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24121211425337572 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

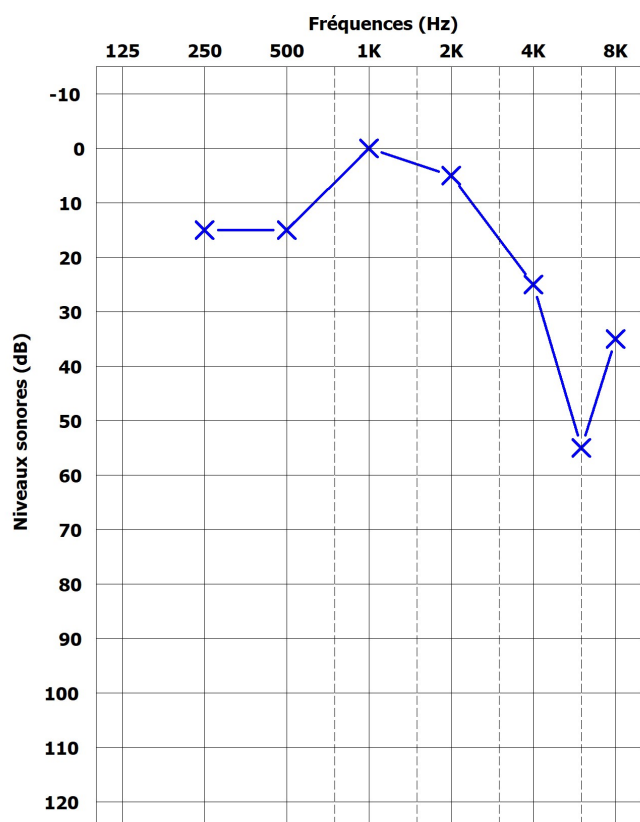

Oreille Gauche

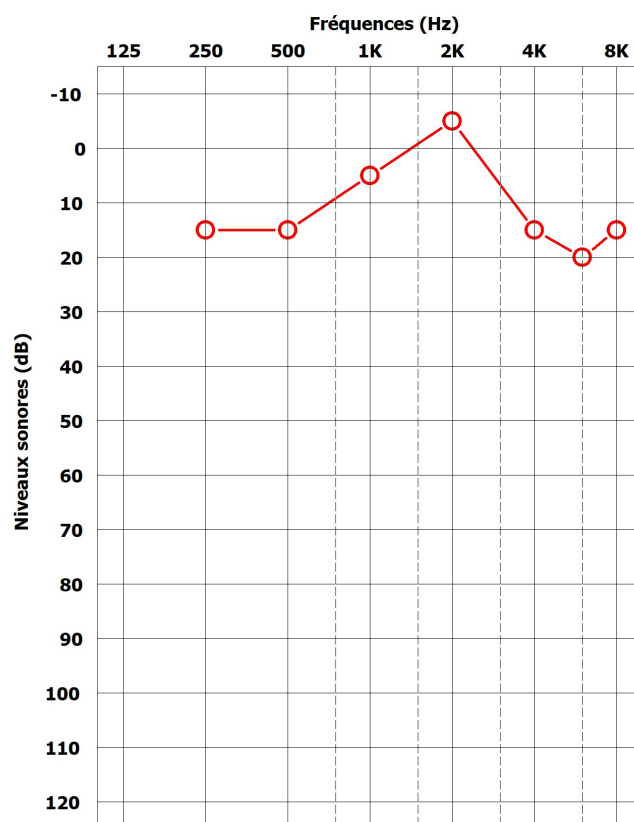

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 15  |     | 0  |     | 5  |    | 25 | 55 | 35 |
| CA Droit  |     | 15  | 15  |     | 5  |     | -5 |    | 15 | 20 | 15 |

| Calcul de perte | PAM |        |
|-----------------|-----|--------|
| CA Gauche       | --- | 0,0 dB |
| CA Droit        | --- | 5,0 dB |

Notes