



| Données Patient   | CISSE LANCY       |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 14/08/1985        |
| Age               | 39                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25031011555497829 |

Date du test: 10/03/2025 12:00:47  
 Durée: 5mn 50s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

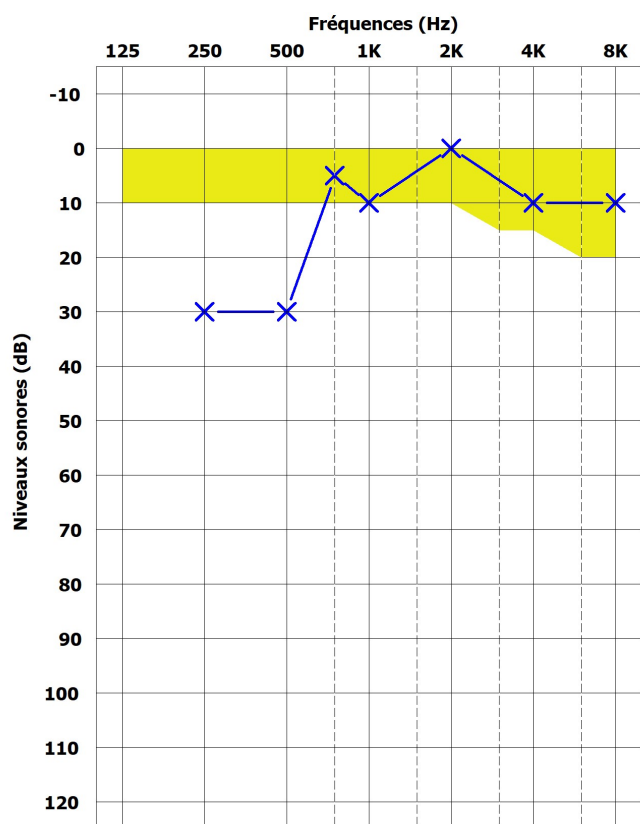

Oreille Gauche

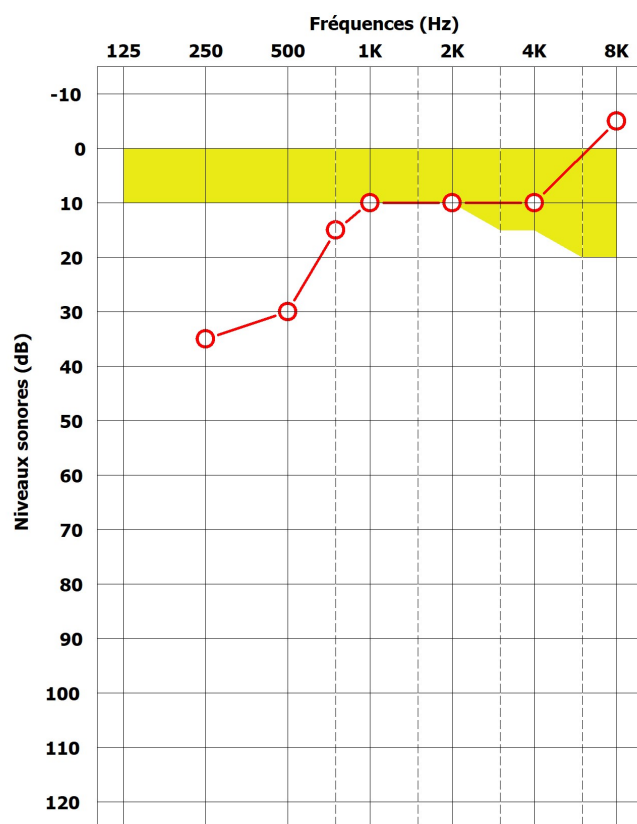

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 30  | 5   | 10 |     | 0  |    | 10 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 35  | 30  | 15  | 10 |     | 10 |    | 10 |    | -5 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 12,5 dB | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes