

MEDVIE BEYLA

Date du test: 02/01/2025 14:57:10

Durée: 6mn 12s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA ISMAEL

Date de naissance 12/10/2000

Age 24

Société CR18


ID 25010214543827529

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

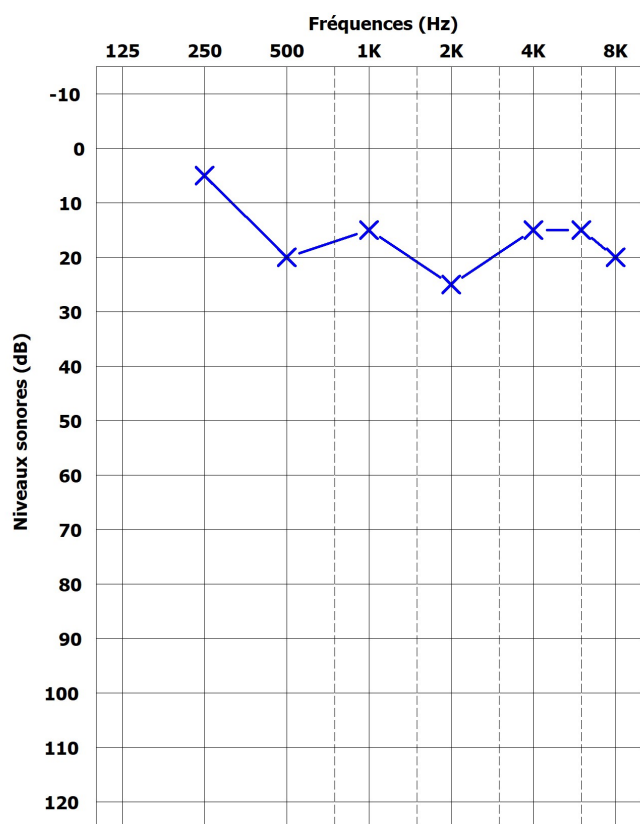

Oreille Gauche

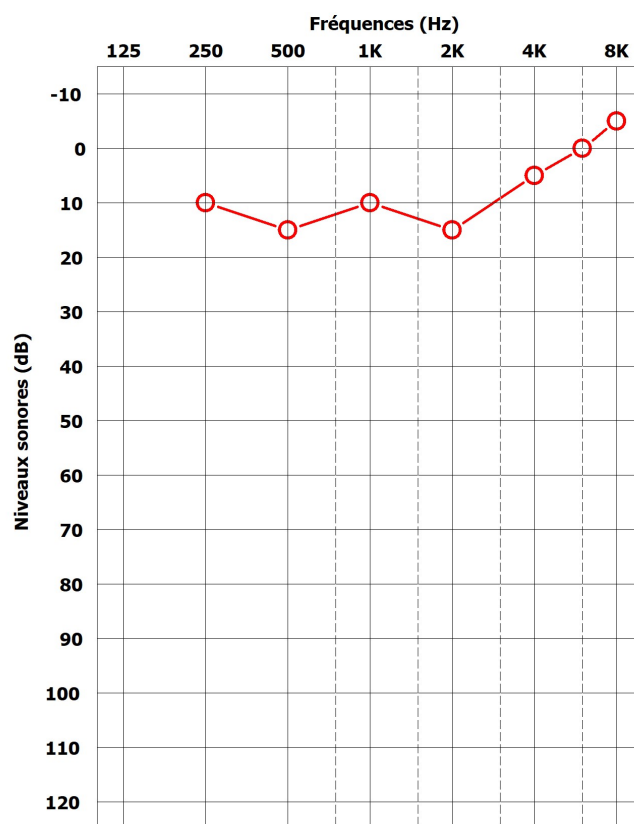

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	20		15		25		15	15	20
CA Droit		10	15		10		15		5	0	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes