


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 14:21:41
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
BAMBA MAMADY	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24051714175165977

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

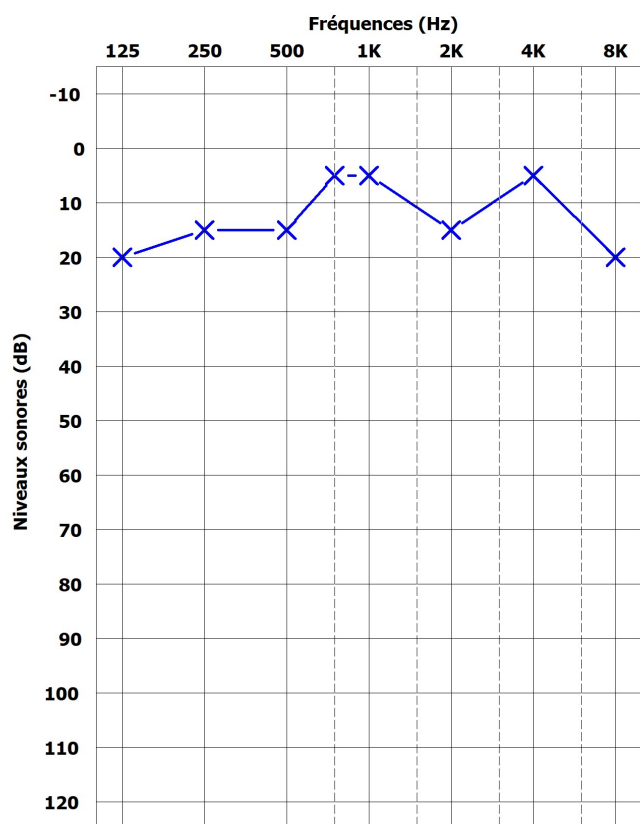

Oreille Gauche

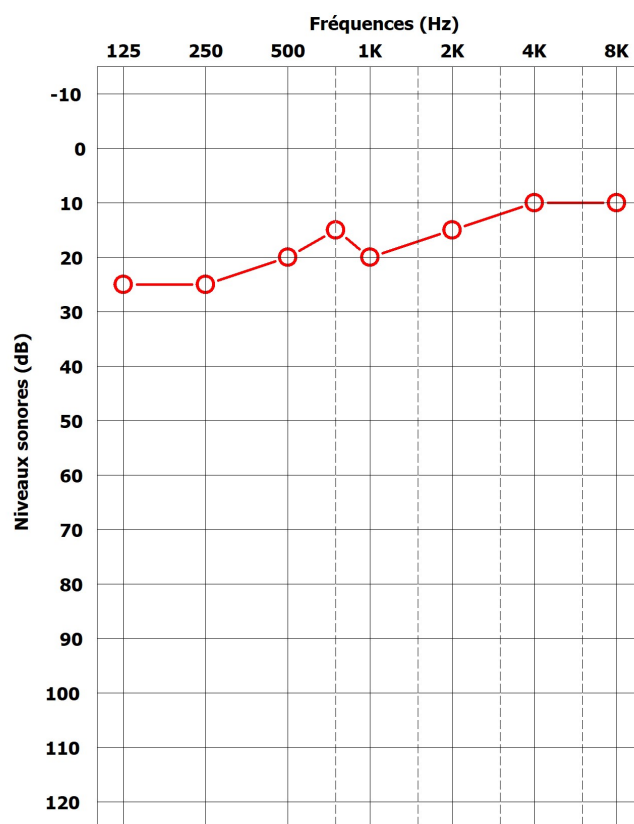

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	5	5		15		5		20
CA Droit	25	25	20	15	20		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes