

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 09:39:20

Durée: 3mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA FODE KADER
Date de naissance	17/06/1995
Age	29
Société	CR18
ID	25031209365623515

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

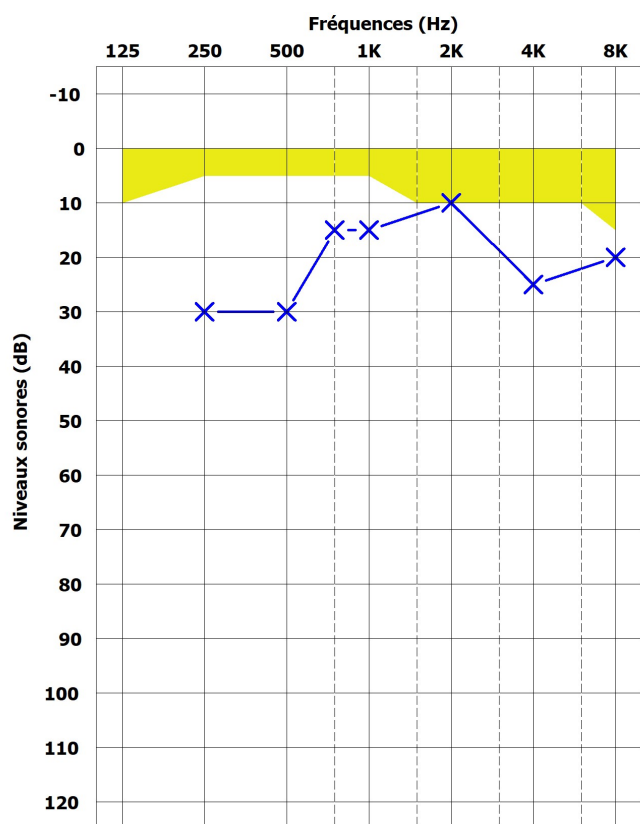

Oreille Gauche

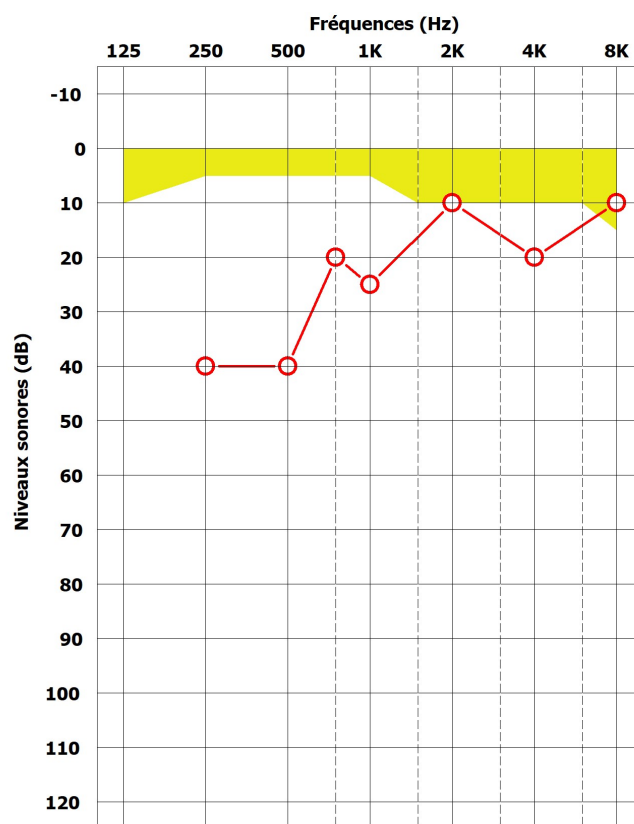

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	15	15		10		25		20
CA Droit		40	40	20	25		10		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes