
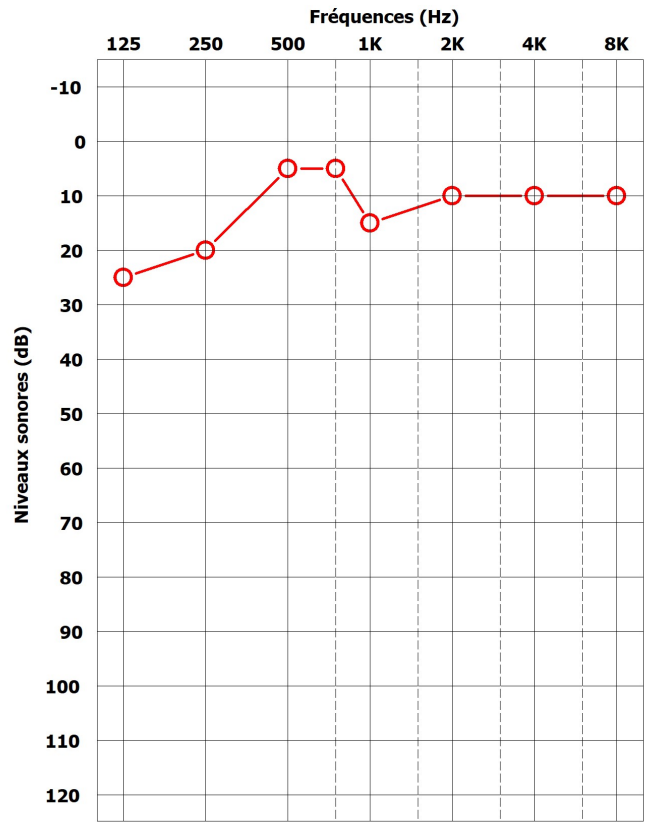


Données Patient		TRAORE SIDIKI
Date de naissance	01/01/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24051711555616157	

Date du test: 17/05/2024 11:58:59
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

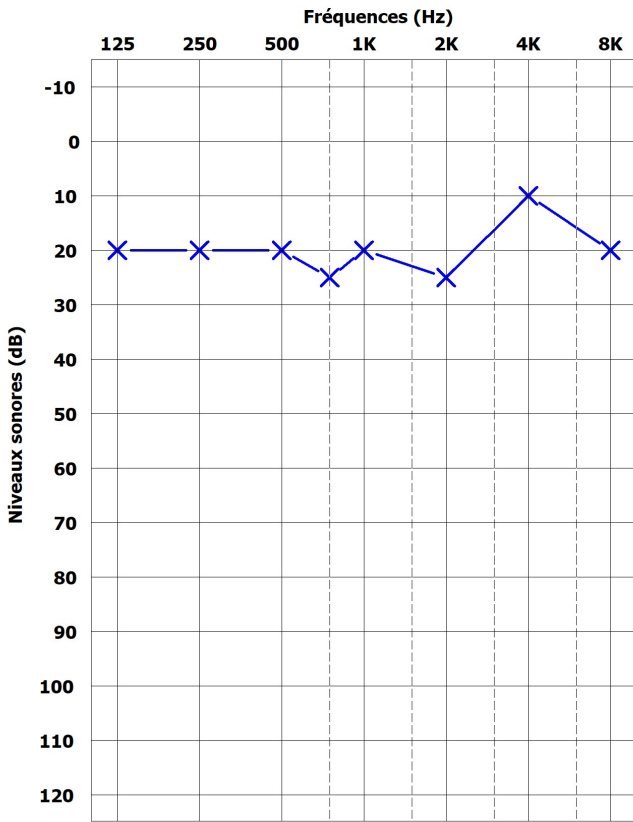

Oreille Gauche

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	25	20		25		10		20
CA Droit	25	20	5	5	15		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	18,8 dB
CA Droit	10,0 dB	---

Notes