


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 15:55:30
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		TRAORE SIDIKI
Date de naissance	01/01/1979	
Age	45	
Société	CR18	
ID	24052015515573470	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

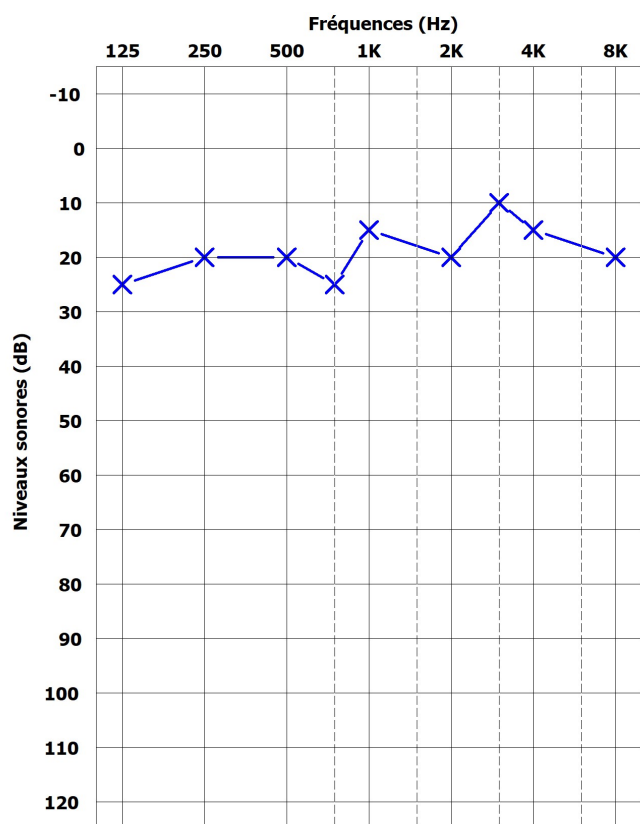

Oreille Gauche

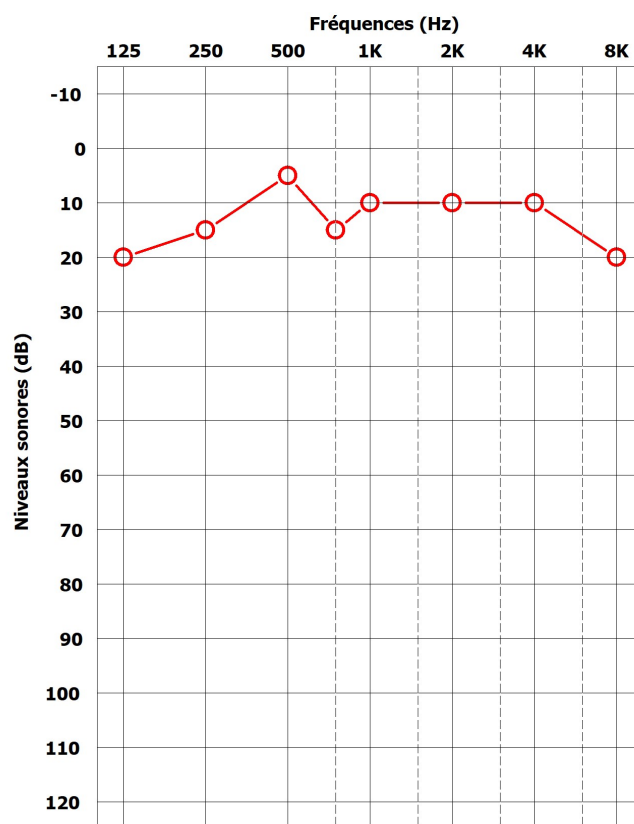

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	25	15		20	10	15		20
CA Droit	20	15	5	15	10		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes