

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 16:09:31

Durée: 12mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TINKIANO BENZAMIN	
Date de naissance	01/01/1978
Age	46
Société	CR18
ID	24032016075514649

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

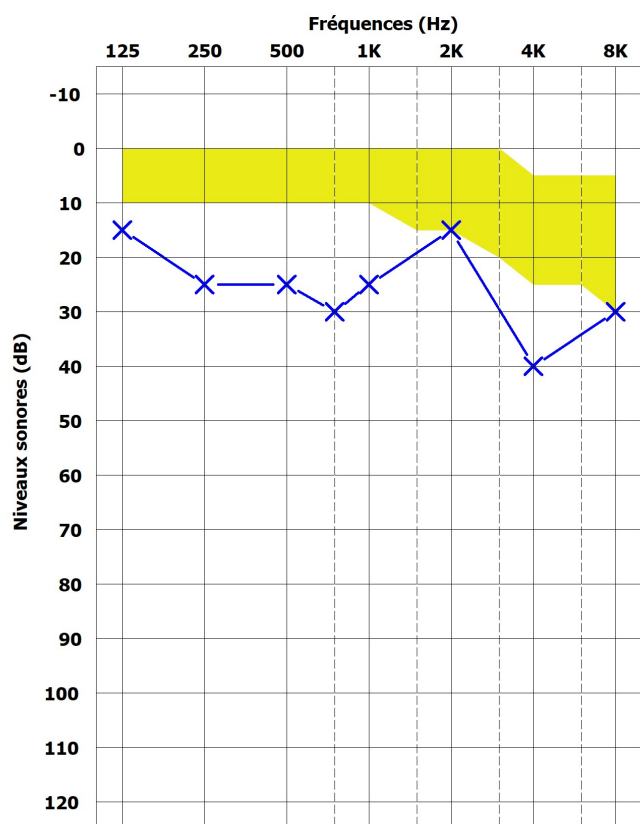

Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	25	25	30	25		15		40		30
CA Droit	5	25	25	20	15		10		35		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes