

MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 08:45:52

Durée: 7mn 45s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAMBA Mohamed	
Date de naissance	01/01/1975
Age	49
Société	CR18
ID	24031807570389357

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

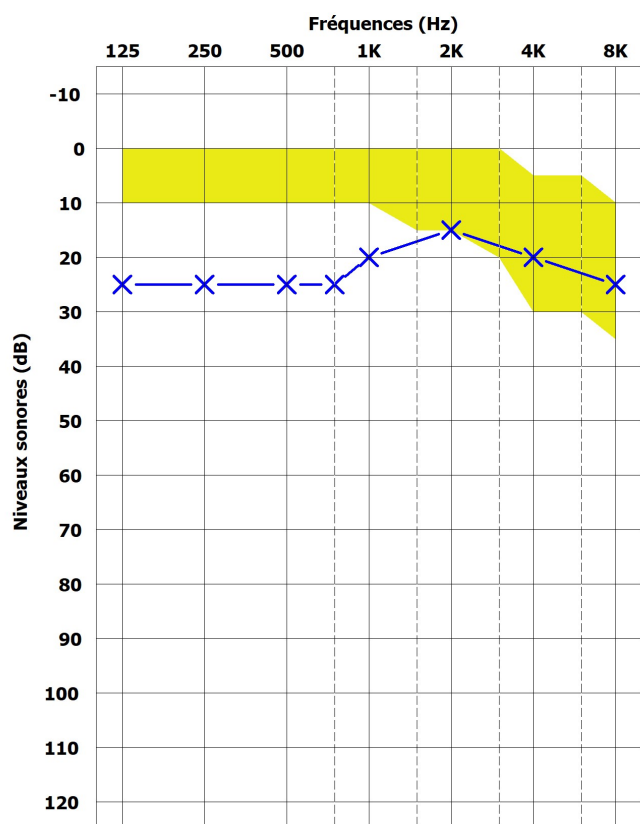

Oreille Gauche

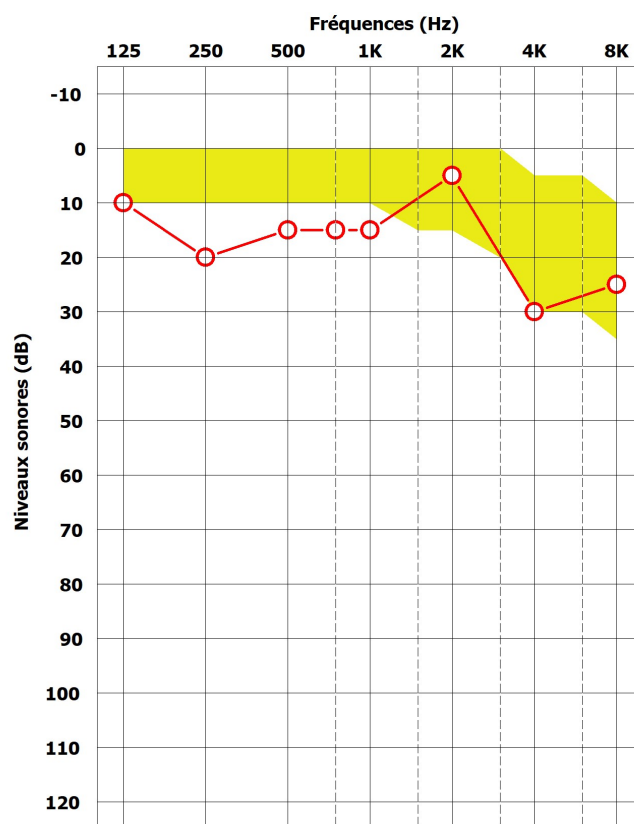

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	25	20		15		20		25
CA Droit	10	20	15	15	15		5		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes