



Données Patient	HE DONGQING
Date de naissance	17/11/1984
Age	40
Société	CR18
ID	25071310402281447

Date du test: 13/07/2025 10:42:52
Durée: 5mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

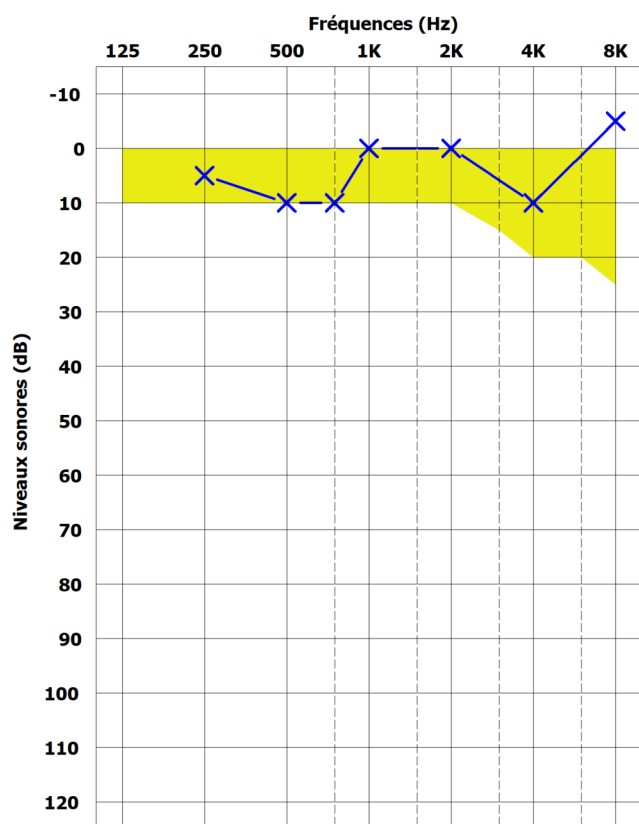

Oreille Gauche

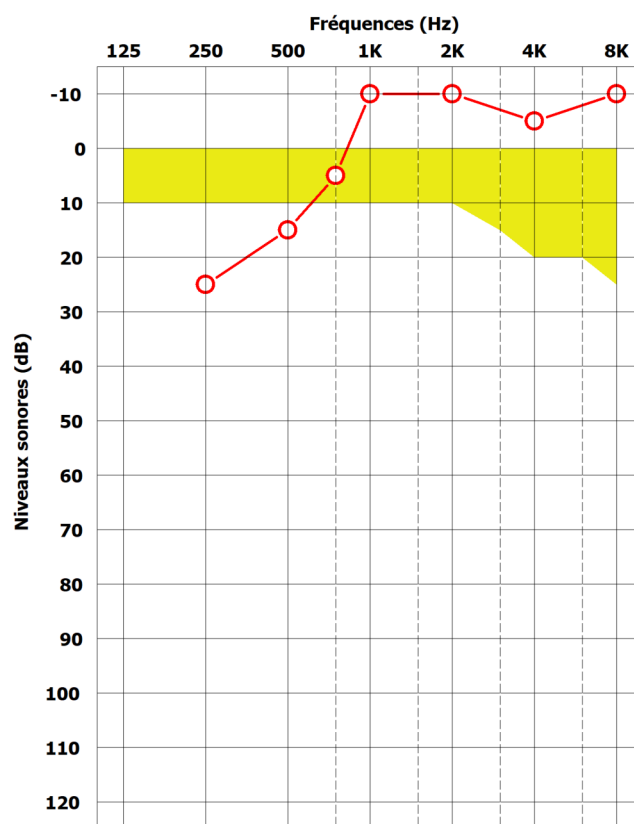

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	0		0		10		-5
CA Droit		25	15	5	-10		-10		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	-2,5 dB	---

Notes