

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 13:47:24

Durée: 4mn 37s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | TRAORE OUSMANE    |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/01/1980        |
| Age               | 45                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25031513175848715 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

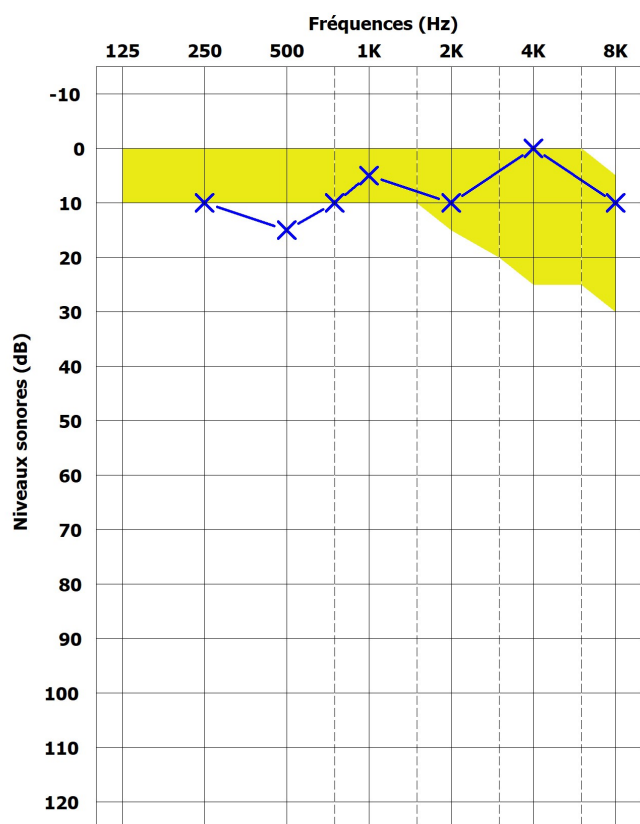

Oreille Gauche

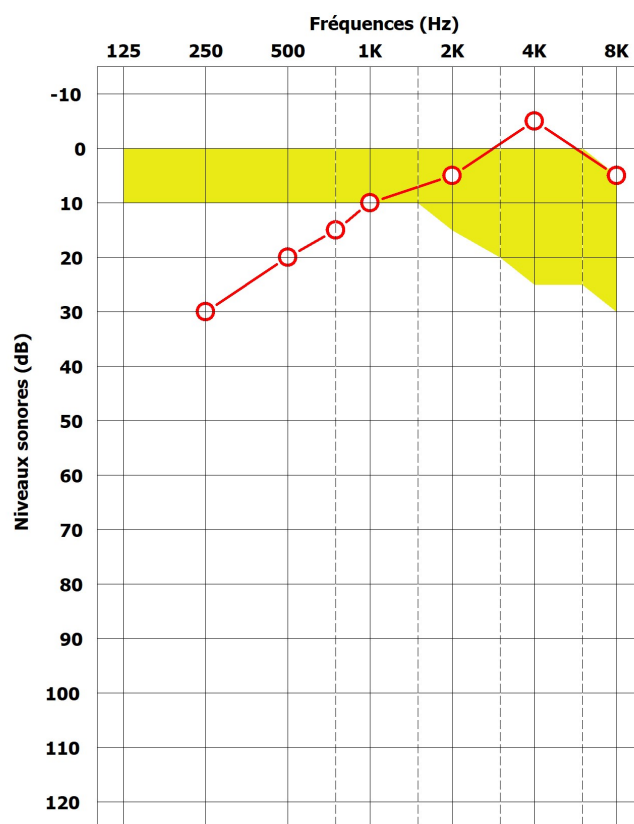

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 15  | 10  | 5  |     | 10 |    | 0  |    | 10 |
| CA Droit  |     | 30  | 20  | 15  | 10 |     | 5  |    | -5 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB | --- |
| CA Droit        | 7,5 dB | --- |

Notes