



Données Patient		CONDE KANKOU
Date de naissance	06/02/1998	
Age	26	
Société	CR18	
ID	25011511545692534	

Date du test: 15/01/2025 11:58:00
 Durée: 2mn 44s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

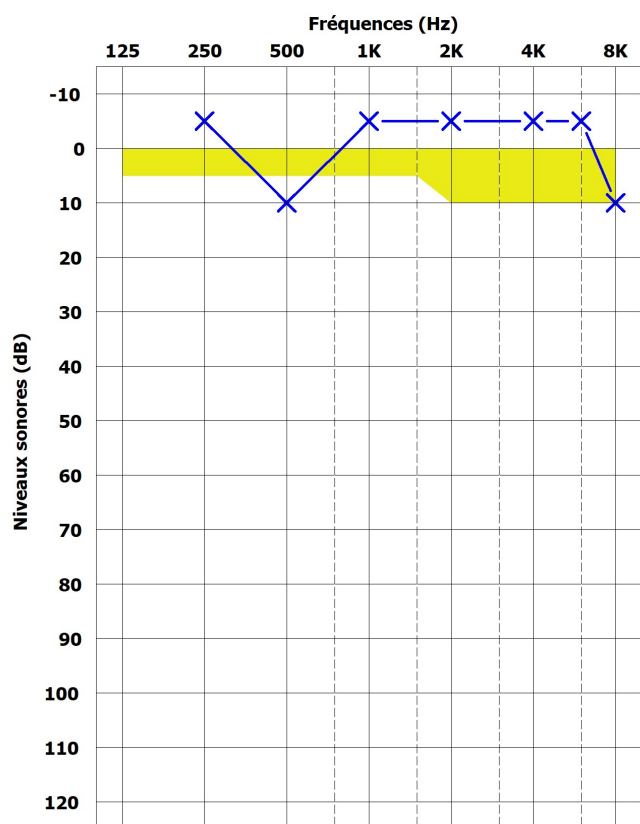

Oreille Gauche

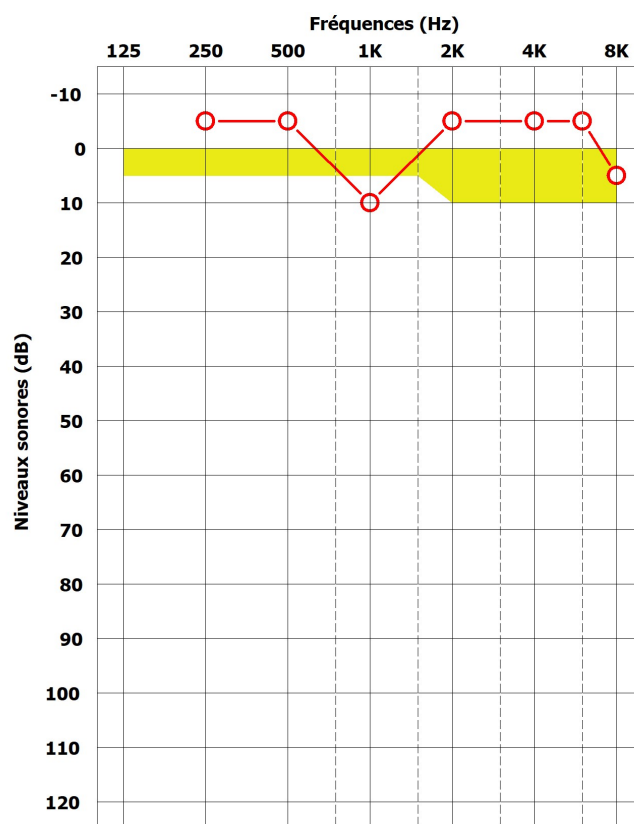

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10		-5		-5		-5	-5	10
CA Droit		-5	-5		10		-5		-5	-5	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	-5,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes